



中华人民共和国医药行业标准

YY/T 1135—2008
代替 YY 91135—1999

骨 剪

Bone scissor

2008-10-17 发布

2010-01-01 实施



国家食品药品监督管理局 发 布

前 言

本标准代替 YY 91135—1999《骨剪》。

本标准与 YY 91135—1999 相比主要变化如下：

——标准中扩充了骨剪的型式；

——标准按 YY 1122—2005《咬骨钳(剪)通用技术条件》的规定，重新进行了修订。

本标准由全国外科器械标准化技术委员会提出并归口。

本标准由上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂负责起草。

本标准主要起草人：刘伟群。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

——YY 91135—1999；

——WS2-222—1976。

骨 剪

1 范围

本标准规定了骨剪的分类与型式、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于供剪切、修整人体骨骼用的骨剪。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1220—2007 不锈钢棒
YY 1122—2005 咬骨钳(剪)通用技术条件

3 分类与型式

3.1 骨剪柄部可制成有柄花或无柄花，骨剪的型式和基本尺寸应符合图 1～图 2 及表 1 的规定。



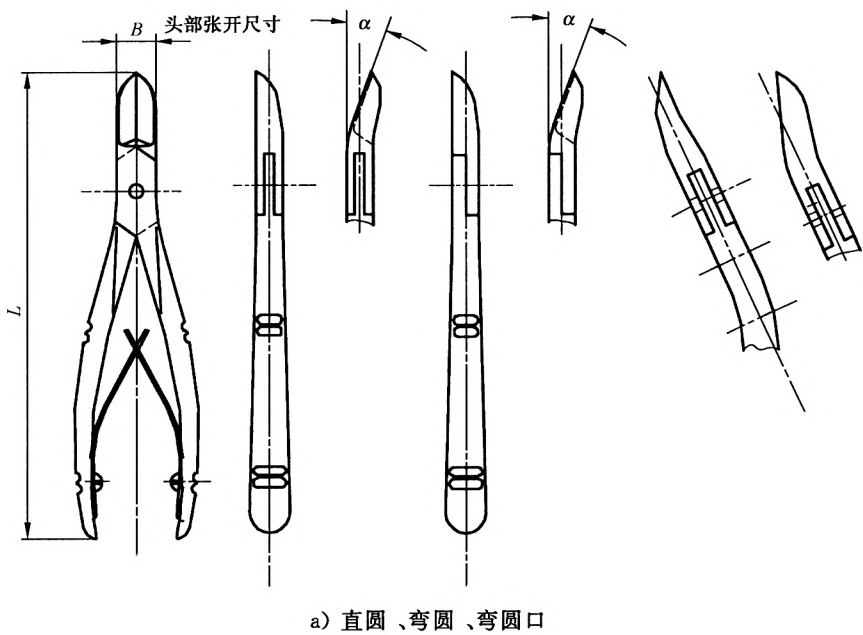


图 1 骨剪(单关节)

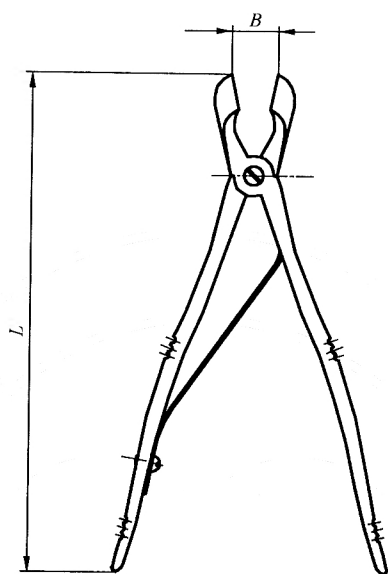


b) 弯头平口

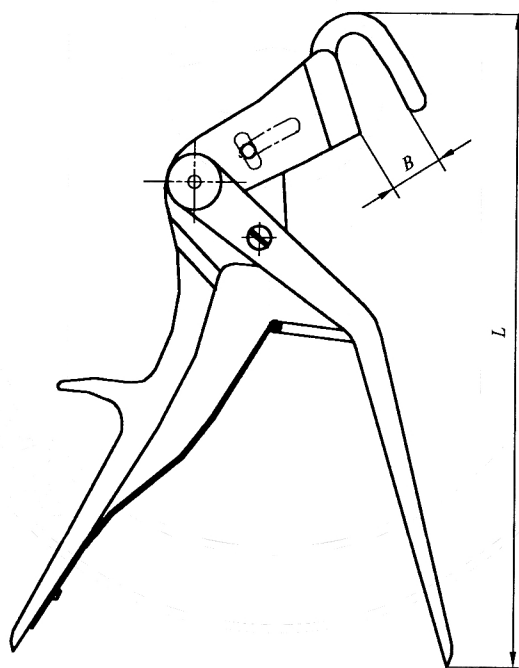


c) 胸骨

图 1 (续)

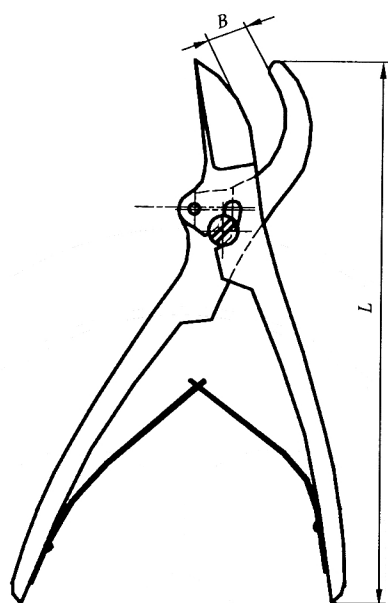


d) 肋骨

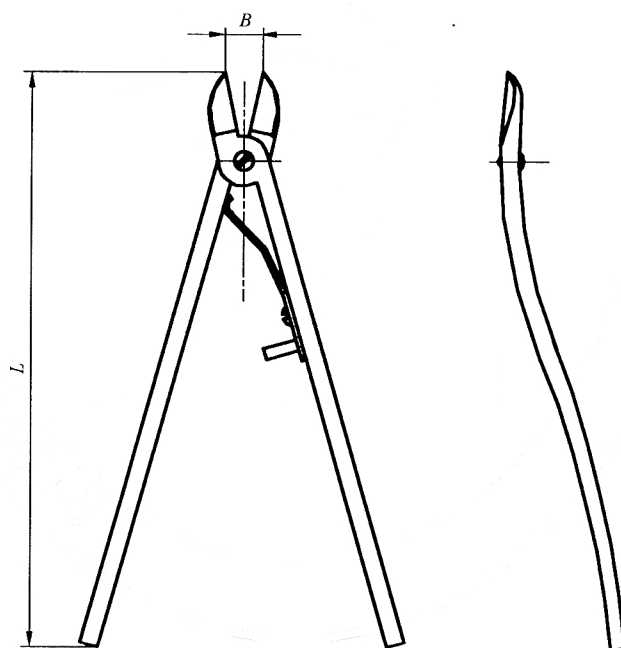


e) 长肋骨

图 1 (续)

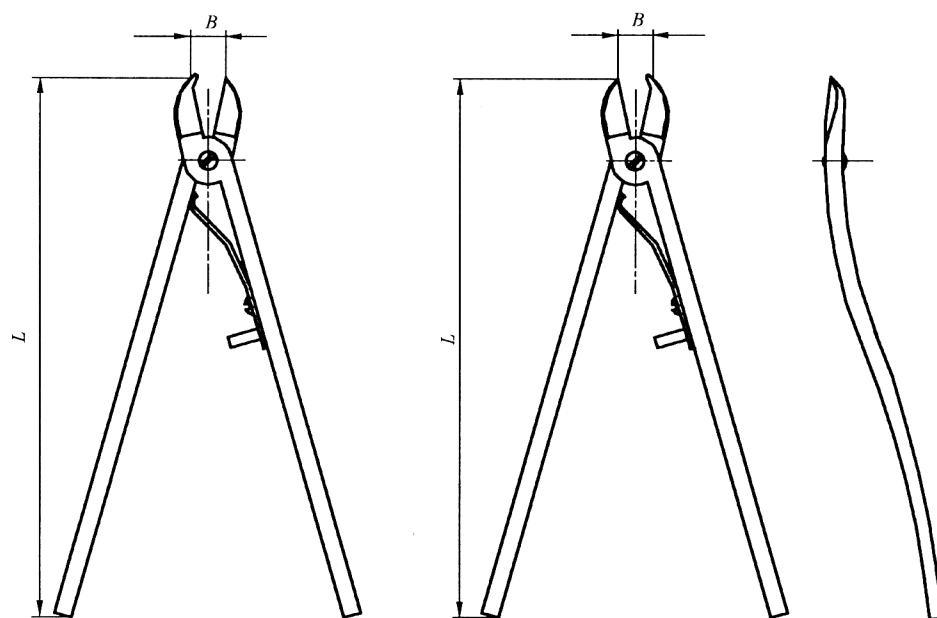


D) 左钩长肋骨、右钩长肋骨

图 1 (续)

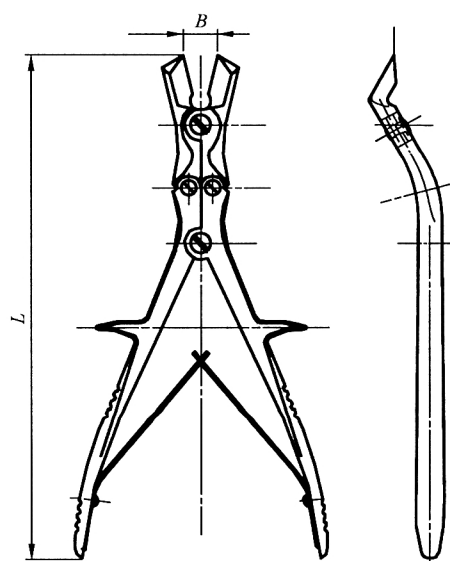

a) 棘突

图 2 骨剪(双关节)

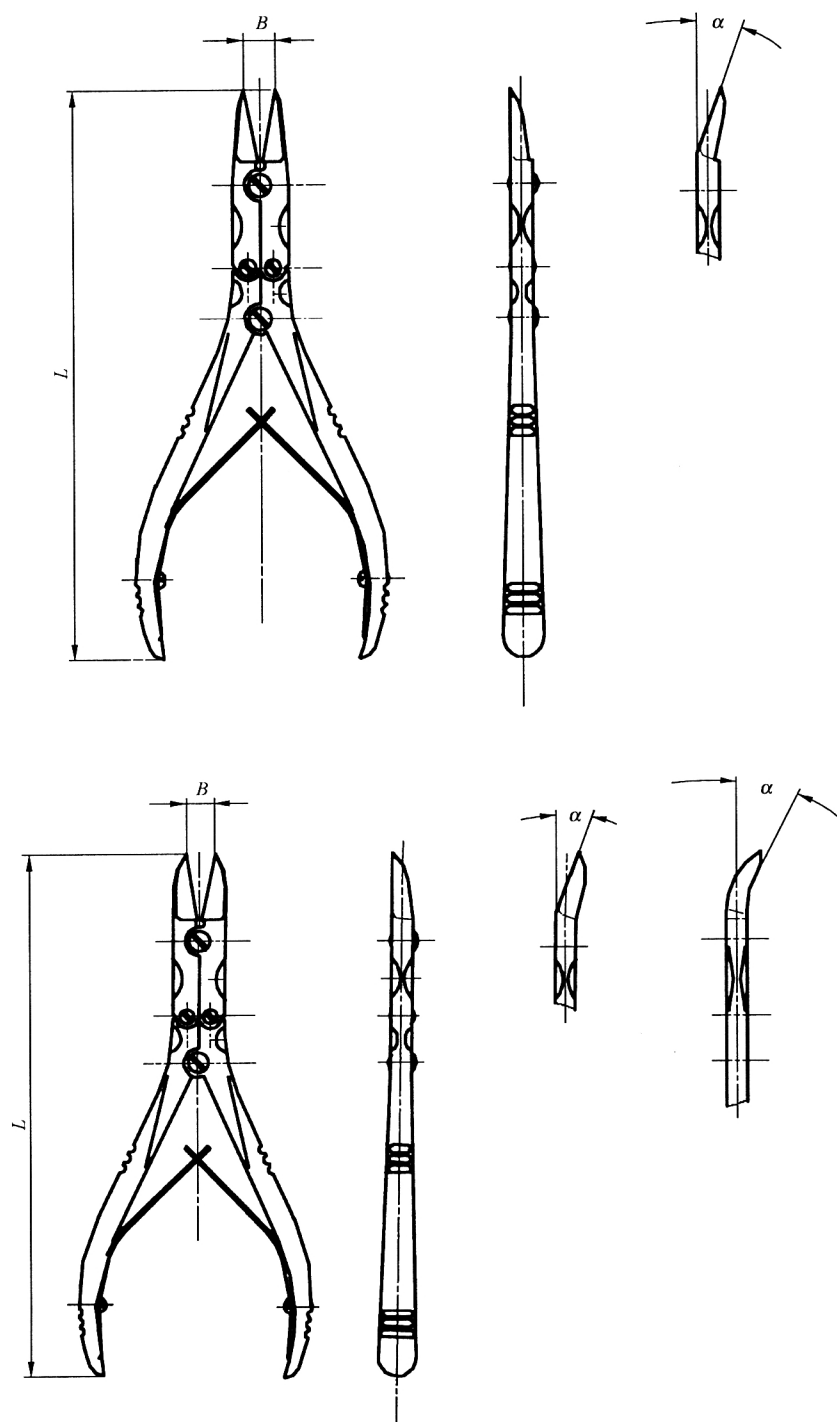

b) 直尖、弯尖、直圆、弯圆、弯圆口

图 2 (续)

表 1 基本尺寸 单位为毫米

型 式		L/mm	B(头部张开尺寸)/mm	α
单关节	直圆、弯圆、弯圆口	120~200	≥ 12	$0^{\circ}\sim 30^{\circ}$
	弯头平口	200~240	≥ 20	—
	胸骨	200~240	≥ 12	—
	肋骨	220(闭合尺寸)	≥ 18	
	长肋骨	340(闭合尺寸)	≥ 18	
	左钩长肋骨 右钩长肋骨			
双关节	棘突	240~260	≥ 12	
	直尖、弯尖 直圆、弯圆 弯圆口	170~280	≥ 10	$0^{\circ}\sim 40^{\circ}$

3.2 骨剪的头部可选用 GB/T 1220 中规定的 30Cr13、32Cr13Mo、40Cr13 材料,也可选用符合第 4 章要求的其他材料。

4 要求

- 4.1 骨剪的尺寸应符合表 1 中 B 的规定。
- 4.2 骨剪的其余要求应符合 YY 1122—2005 中第 4 章的规定。

5 试验方法

骨剪的试验方法应符合 YY 1122—2005 中第 5 章的规定。

6 检验规则

骨剪的检验规则应符合 YY 1122—2005 中第 6 章的规定。

7 标志、使用说明书

骨剪的标志、使用说明书应符合 YY 1122—2005 中第 7 章的规定。

8 包装、运输、贮存

骨剪的包装、运输、贮存应符合 YY 1122—2005 中第 8 章的规定。

中 华 人 民 共 和 国 医 药
行 业 标 准
骨 剪
YY/T 1135—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*


开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 13 千字
2009年4月第一版 2009年4月第一次印刷

*

书号: 155066 • 2-19587 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

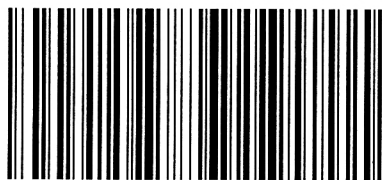

YY/T 1135-2008