



الدليل التنظيمي

لإجراءات تسجيل المستلزمات الطبية المستوردة
والمحلية الحاصلة على شهادات جودة عالمية

محتوي الدليل

الصفحة	المحتوي
2	1- مقدمة
2	2- تعريفات
3	3- الأدلة ذات الصلة
4	4- الإجراءات و القواعد المنظمة 4.1 الإجراءات والقواعد المنظمة لتسجيل المستلزمات الطبية المعقمة المستوردة والمحلية الحاصلة على شهادات الجودة العالمية 4.1.1 إجراءات استقبال ملفات التسجيل 4.1.2 إجراءات تقييم ملف تسجيل مستلزم طبي 4.1.3 إجراءات استيفاء ملف تسجيل مستلزم طبي 4.2 الإجراءات والقواعد المنظمة لتسجيل المستلزمات الطبية الغير معقمة المستوردة والمحلية الحاصلة على شهادات الجودة العالمية 4.2.1 إجراءات تسجيل المستلزمات الطبية الغير معقمة المستوردة المصنفة class IIa,IIb,III 4.2.2 إجراءات تسجيل المستلزمات الطبية الغير معقمة المحلية المصنفة class IIa,IIb,III 4.2.3 تسجيل المستلزمات الطبية الغير معقمة كمنظومة واحدة System 4.2.4 تسجيل المستلزمات الطبية الغير معقمة بنظام التجميع bundling
10	5- الإجراءات و القواعد المنظمة للجان العلمية المتخصصة
16	6- الإجراءات و القواعد المنظمة للجنة العلمية المتخصصة لتقييم دراسة الثبات و التوافق الحيوي
19	7- إجراءات اللجنة المختصة بتسجيل المستلزمات الطبية
20	8- مأمونية المستلزمات الطبية
20	9- اصدار إخطار التسجيل
20	10- إجراءات إعادة التسجيل
21	11- اشتراطات عامة
23	12- قائمة المستندات المطلوبة لتسجيل المستلزمات الطبية و ملاحق الطلبات - ملحق (1): قائمة المستندات المطلوبة لتسجيل المستلزمات الطبية المستوردة المقدمة للتسجيل الجديد/إعادة تسجيل معقمة أو غير معقمة. - ملحق (2): قائمة المستندات المطلوبة لتسجيل المستلزمات الطبية محلية الصنع المقدمة للتسجيل الجديد/إعادة التسجيل معقمة أو غير معقمة. - ملحق (3): قائمة المستندات المطلوبة لتسجيل المستلزمات الطبية المقدمة للتسجيل بنظام التصنيع لدى الغير (F-TOLL). - ملحق (4): المستندات المطلوبة للعرض على اللجان العلمية المتخصصة - ملحق (5): قائمة المستندات المطلوبة للعرض على اللجنة العلمية المتخصصة لتقييم دراسات الثبات (biocompatibility) - ملحق (6): التعهدات الخاصة بمأمونية المستلزمات الطبية
41	13- قائمة المصطلحات والاختصارات (Glossary)

1. مقدمة

هذا الدليل يخص الإجراءات التنظيمية لتسجيل المستلزمات الطبية المستوردة والمحلية الحاصلة على شهادات جودة عالمية

2. تعريفات

1. **المستلزم الطبي**: أي جهاز أو أداة أو وسيلة أو ماكينة أو معدة أو اله أو تطبيق و يشمل ذلك ما يتم غرسه أو زرعه أو برنامج إلكتروني أو مادة أو أي أشياء أخرى مشابهه أو ذات صلة و التي تكون الشركة المصنعة قامت بتصنيعها بغرض الاستخدام البشري منفردة أو مجتمعة لواحدة أو أكثر من الأغراض التالية :
- التشخيص، الوقاية ، المراقبة ، العلاج ، التخفيف من حدة المرض.
 - تشخيص، رصد، علاج، تخفيف، تعويض الإصابة.
 - التحقق من إستبدال أو تعديل أو دعم العملية التشريحية او الوظيفية.
 - دعم أو الحفاظ على الحياة
 - تنظيم الحمل.
 - تعقيم الأجهزة الطبية.

بشرط ألا يتحقق الغرض الأساسي المقصود به عن طريق التأثير الدوائي أو المناعي أو الأيضي في جسم الإنسان أو عليه و لكن يمكن مساعدة المستلزم الطبي في وظيفته المقصودة بالتأثيرات سالفة الذكر.

2. **المستلزمات الطبية المستوردة**: المستلزمات الطبية التي يتم إستيرادها تامة الصنع من الخارج للتداول داخل جمهورية مصر العربية
3. **المستلزمات الطبية المحلية** : المستلزمات الطبية التي يتم تصنيعها في مصانع داخل جمهورية مصر العربية
4. **طالب التسجيل** : الشركة المستوردة , المصنع المحلي , أو مكتب علمي .
5. **ممثل طالب التسجيل** : المندوب المفوض من طالب التسجيل لمتابعة جميع الأعمال داخل إدارة التسجيل .
6. **المستلزم الطبي الغير معقم** : هو المستلزم الطبي الذي يتم تصنيعه دون تعقيمه ويستخدم بحالته الغير معقمة أو يتطلب الأمر تعقيمه بمعرفة المستخدم قبل الإستعمال .
7. **الشركة المستوردة** : الكيان الأول في سلسلة التوريد الذي يقوم بإستيراد المستلزم الطبي المصنَّع في الخارج إلى جمهورية مصر العربية
8. **نظام التسجيل بالمسار العادي (normal track)** : إتمام إجراءات التسجيل وفقاً لقائمة الإنتظار لدي إدارة تسجيل المستلزمات الطبية
9. **نظام التسجيل بالمسار السريع (fast track)** : إتمام إجراءات التسجيل طبقاً لجدول زمني دون التقيد بقائمة الإنتظار
10. **التصنيع لدى الغير (Toll)**:

- **المصنع**: هو المصنع الفعلي للمستلزم الطبي و هو:
 - مصنع مرخص من جهة الاختصاص وفقاً للقواعد المتبعة.
 - حاصل على شهادات CE & ISO 13485:2016 صادرة من جهة منح شهادات معتمدة دولياً.
 - مع توافر خط الانتاج برخصة المصنع.
- **صاحب اخطار التسجيل أو "License Holder"**:
 - هو المصنع المتقدم لتسجيل المستلزم الطبي الذي سوف يقوم بتصنيعه لدى الغير (المصنع) و هو:
 - مصنع مرخص وفقاً للقواعد المتبعة (مصنع مستلزمات او دواء).
 - حاصل على شهادات CE & ISO 13485:2016 صادرة من جهة منح شهادات معتمدة دولياً على ان تغطي مكان التصنيع الفعلي.
 - هو المسئول القانوني عن المستلزم الطبي.

- في الوقت الحالي ليس لديه خط انتاج المستلزم الطبي المقدم له طلب تسجيل او لديه خط الإنتاج والطاقة الإنتاجية أقل من المطلوب إنتاجه فعلياً.
- المصنع القانوني: هو الكيان المسنول عن تصميم المستلزم الطبي و تصنيعه و تعبئته و توزيعه قبل طرحه في السوق باسمه, بغض النظر عما اذا كان قد تم تنفيذ هذه العمليات من قبل ذلك الشخص بنفسه او نيابة عنه او بواسطة طرف ثالث و هو المسنول عن جودة المنتج
- تعريف المصنع الفعلي: هو مكان تصنيع المستلزم و تعبئته و تغليفه لصالح المصنع القانوني

11. قائمة الدول المرجعية (Reference Countries):


- بلجيكا - فرنسا - ألمانيا - إيطاليا - لوكسمبورغ - هولندا - النمسا - فنلندا - السويد - النرويج - الدنمارك - أيرلندا - المملكة المتحدة- اليونان - البرتغال - إسبانيا - بلغاريا - رومانيا - قبرص - جمهورية التشيك - إستونيا - المجر - لاتفيا - ليتوانيا - مالطا - بولندا - سلوفاكيا - سلوفينيا- أستراليا - نيوزيلندا - أمريكا - كندا - اليابان - أيسلندا- سويسرا.

3. الأدلة ذات الصلة:

الدليل الإرشادي للاشتراطات الفنية لمصانع المستلزمات الطبية

4. الإجراءات والقواعد المنظمة:
4.1. الإجراءات والقواعد المنظمة لتسجيل المستلزمات الطبية المعقمة (المستوردة والمحلية الحاصلة على شهادات الجودة العالمية)

Flow Chart (1) of Registration of Medical Devices

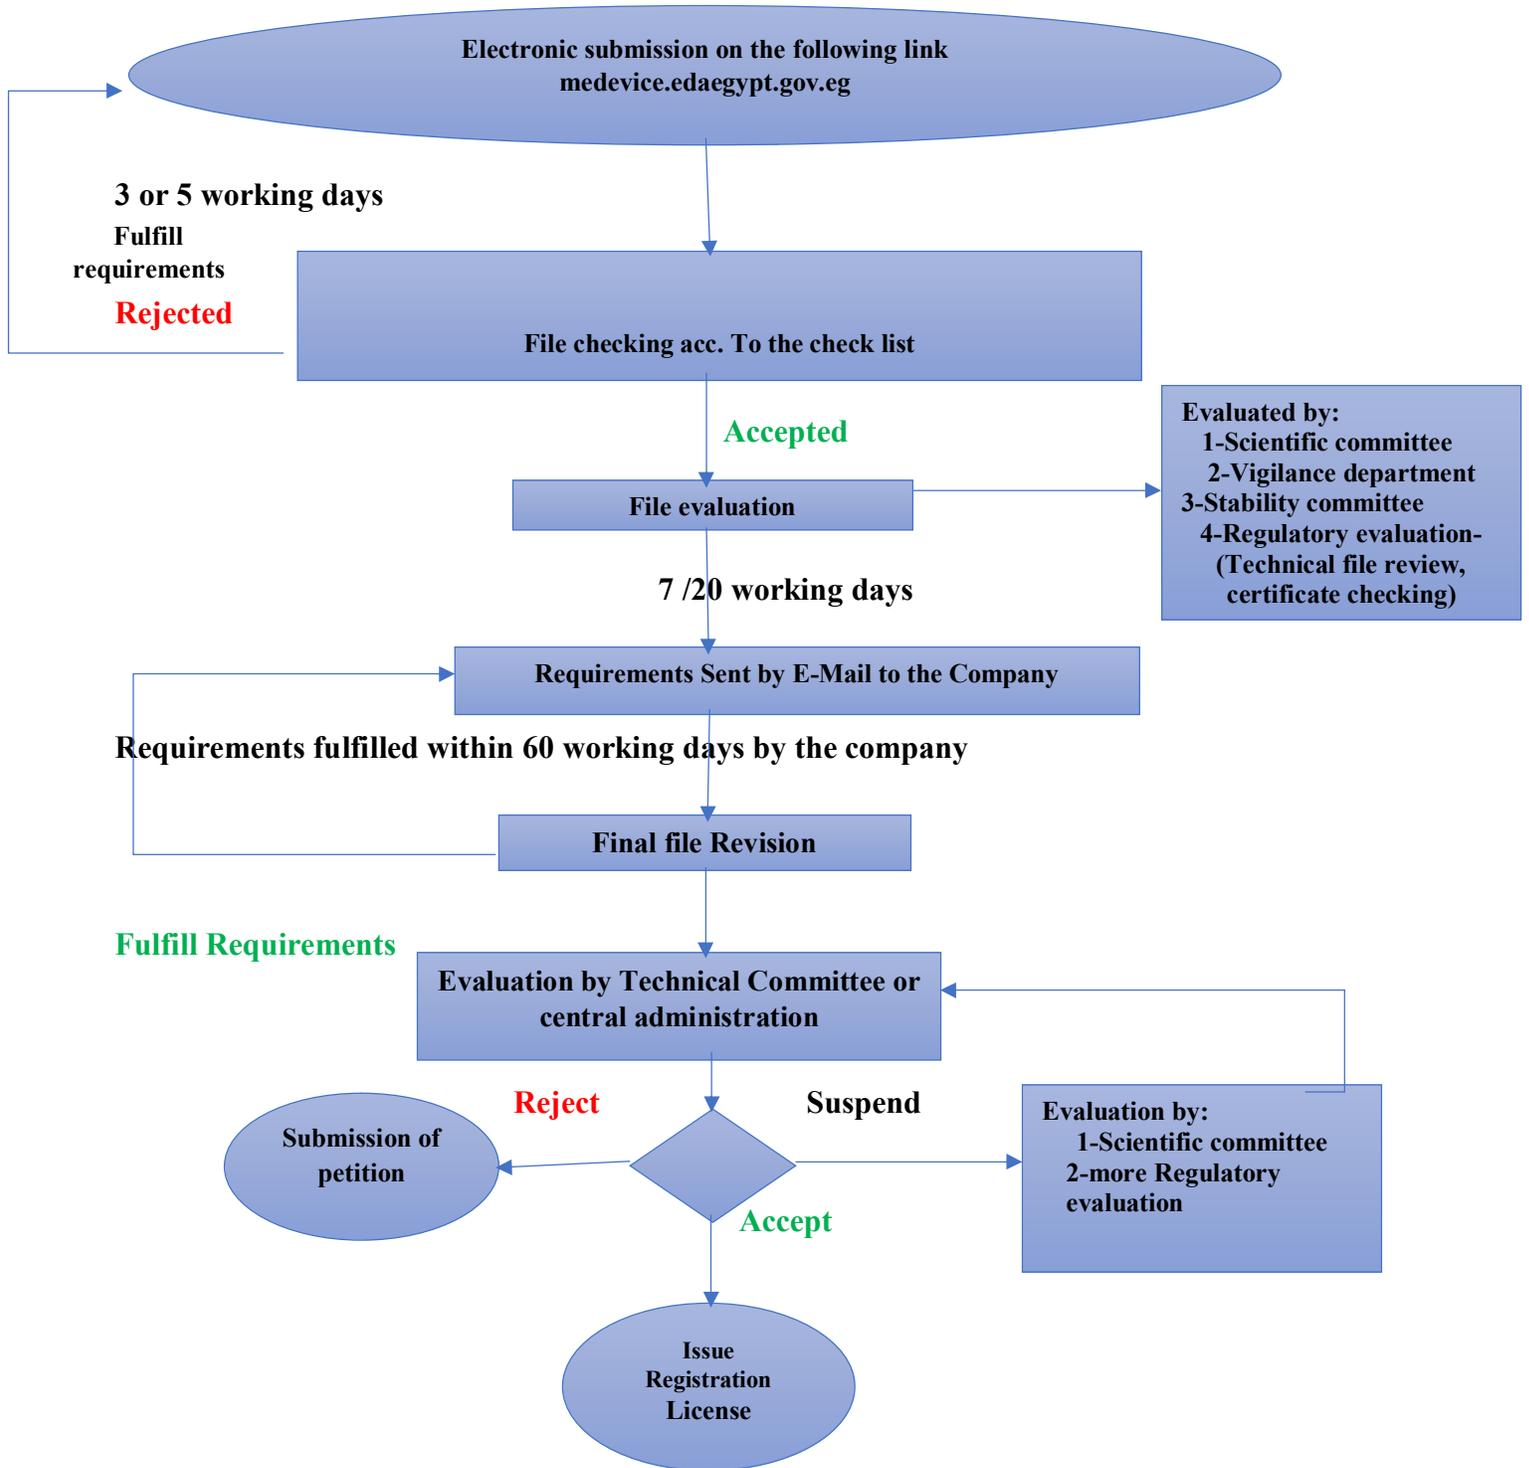

4.1.1. إجراءات استقبال ملفات تسجيل المستلزمات الطبية :

1- يقوم قسم الاستقبال بمقابلة ممثل طالب التسجيل لإضافة اسم المستلزم الطبي على إيصال السداد الخاص بالرسوم و مقابل الخدمات وتحديد الإدارة المعنية (محلى- مستورد)

يتم تحصيل رسم طلب تسجيل مستلزم طبي طبقاً لفئة الرسم الواردة باللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية " الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 777 لسنة 2020 " و مقابل الخدمات طبقاً للقرار الصادر من رئيس هيئة الدواء في هذا الشأن

2- تقوم الشركة بالتقديم على الرابط التالي :

medevice.edaegypt.gov.eg

3- يتم الرد على الشركة من خلال المنصة و ذلك خلال 5 ايام عمل من تاريخ ارسال الطلب للـ **normal track** و 3 ايام عمل الـ **fast track** بقبول او عدم قبول الملف او تعليق الطلب لحين الاستيفاء

◀ في حالة قبول الملف : يتم توجيه الطلب للصيدلى المراجع و رئيس القسم للدراسة و الافادة وارسال الاستكمالات للشركة

◀ في حالة تعليق الطلب لحين الاستيفاء: يتم تعليق الملف في حالة عدم استيفائه أي من المستندات طبقاً لقائمة المستندات المعلنة **checklist** لمدة أقصاها 90 يوم عمل بعدها يعتبر الطلب لاغى. عند استيفاء الشركة للإستكمالات المطلوبة يتم إستكمال الطلب على المنصة من خلال نفس رقم الطلب المقدم سابقا .

◀ في حالة رفض الطلب : يتم رفض الطلب في حالة عدم تطابق أي من بيانات المستلزم في طلب الشركة مع الايصال او الطلب لا يخص الادارة الموجه لها الطلب

4.1.2. إجراءات تقييم ملف تسجيل مستلزم طبي:

• يتم مراجعة الملف و إرسال الإستكمالات المطلوبة على المنصة و ذلك في خلال 20 يوم عمل من تاريخ إستلام الملف الـ **normal track** و7 ايام عمل لملفات الـ **Fast track**.

• يتم إتباع الإجراءات الخاصة بأمنية المستلزمات الطبية كما هو مذكور تفصيلاً في البند 8 .

4.1.3. إجراءات إستيفاء ملف تسجيل مستلزم طبي

- يتم إرسال إستكمالات ملف التسجيل عبر المنصة medevice.edaegypt.gov.eg

يتم الإلتزام بالتالي بخصوص المستندات المرفوعة علي المنصة الإلكترونية من قبل الشركات :

- مستندات أصلية
- مختومة بخاتم الشركة
- بامضاء ممثلها القانوني
- سواء كان ذلك عن طريق مسحها ضوئياً ثم رفعها أو عن طريق استخدام التوقيع الإلكتروني ملحوظة : عدم قبول غير ذلك من مستندات إلكترونية

4.2. الاجراءات والقواعد المنظمة لتسجيل المستلزمات الطبية الغير معقمة (المستوردة والمحلية الحاصلة على شهادات الجودة العالمية)

4.2.1 اجراءات تسجيل المستلزمات الطبية الغير معقمة المستوردة المصنفة class II a ,IIb , III :

في حالة توفر ملف تسجيل كامل طبقاً للـ **check list (ملحق 1)** يتم إتباع نفس الخطوات و القواعد المذكورة في الفقرة 4.1 كما هو موضح في workflow no.1 .

في حالة توفر ملف تسجيل ميدني فقط أي عدم توفر ملف تسجيل كامل طبقاً للـ **check list (ملحق 1)**

يتم إتباع الإجراءات التالية كمسار بديل كما هو موضح بالـ **workflow no.2:** يقوم طالب التسجيل بالتوازي بتقديم ملف تسجيل ميدني على الرابط التالي md.nonsterilereg@edaegypt.gov.eg يحتوي على نسخة من الشهادات المقدمة الي الادارة العامة للسماح بالتداول لكل مستلزم طبي .

يكتفى بتقديم المستندات التالية في ملف التسجيل الميدني:

- Declaration of conformity
- CE certificate
- ISO 13485:2016
- شهادة تداول من بلد مرجعي في حالة المستلزمات المصنفة Class II b, III
- شهادة تداول من بلد المنشأ في حالة المستلزمات الطبية المصنفة Class II a

• في ملف التسجيل الميدني :

- للمستلزمات المصنفة Class IIa : يكتفى بتقديم شهادة تداول من بلد غير مرجعي في حالة عدم توافر شهادة تداول من إحدى الدول المرجعية على ان يتم تقديم شهادة التداول من إحدى الدول المرجعية خلال المهلة (6 شهور).
- في حالة عدم توافر شهادة الـ ISO 13485:2016 لجميع المستلزمات الطبية بمختلف تصنيفاتها يتم استقبال الملف مؤقتاً على ان يتم تقديمهما خلال مهلة الستة أشهر
- في حالة اعتبار ان أي من البنود المذكورة في الفاتورة المقدمة في طلب الحصول على الموافقة الإستيرادية جزء من مجموعة مستلزمات غير معقمة يتم تقديم ملف تسجيل لجميع بنود المجموعة في نفس ملف التسجيل الميدني .

خطوات العمل:

- 1- يتم منح أرقام قبول مؤقتة من قبل إدارة التسجيل بناء على الطلب المقدم والشهادات المرفقة.
- 2- يتم إصدار الموافقة الإستيرادية بعد الحصول على الرقم الميدني المؤقت من خلال ادارة التسجيل .
- 3- يتم منح الشركات مهلة 18 شهر من تاريخ قبول ملف التسجيل الميدني لإستكمال باقى ملف التسجيل على ان تكون اول ستة اشهر لاستكمال المستندات الاساسية في ملف التسجيل طبقاً للملحق 1
- تقوم الشركة خلال الـ 6 شهور الأولى بتقديم ملف التسجيل طبقاً للملحق 1 على الرابط التالي :


medevice.edaegypt.gov.eg

- بعدها يتم منح الشركة رقم قبول نهائي ثم تمنح الشركة مهلة للاستيراد لمدة عام لحين الانتهاء من اجراءات التسجيل كما هو متبع في البند 4.1
- 4- لن يتم الموافقة على إصدار أى موافقة استيرادية بعد انتهاء المدة المشار اليها سابقاً دون إستكمال المستندات المطلوبة طبقاً للـ **check list (ملحق 1)**.

ملحوظة :

- في حالة تكرار إستيراد نفس البند المقدم للتسجيل في اكثر من موافقة استيرادية تقوم الشركة بإستخدام نفس رقم التسجيل المؤقت دون الرجوع لادارة التسجيل لاثبات ذلك.
- يُسمح لطالب التسجيل التقدم بملف تسجيل مبدئي دون التقيد بالتقدم للحصول على موافقة إستيرادية .

Flow Chart (2) of Registration for Medical Devices Class IIa, IIb, III

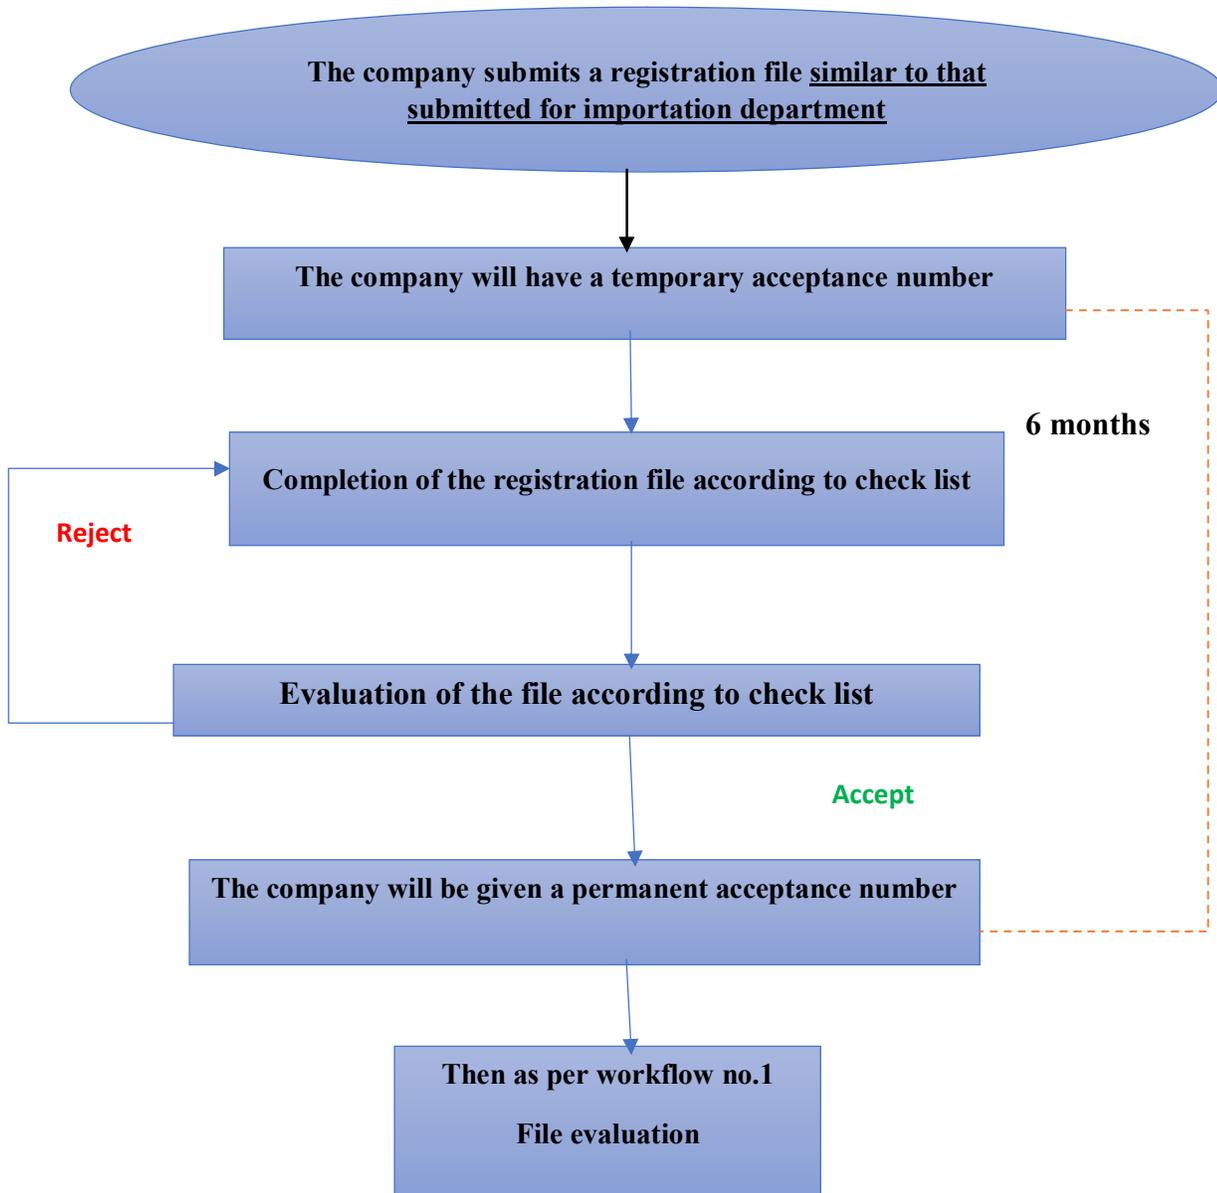

4.2.2 المستلزمات الطبية الغير معقمة المحلية المصنفة class IIa , IIb , III :

- يتم منح المصانع مهلة توفيق أوضاع عامين من تاريخ صدور الدليل لإنهاء إجراءات التسجيل -
 خلال فترة توفيق الأوضاع يكون التداول على مسنولية المصنع كما هو متبع قبل صدور الدليل الإرشادي .
 - على أن تكون اول 6 شهور مهلة لتقديم ملف مبدئي يكتفى بتقديم المستندات التالية في ملف التسجيل المبدئي:

- Declaration of conformity
- CE certificate
- ISO 13485:2016
- شهادة تداول من بلد مرجعي (إن وجد)

خطوات العمل:


- 1- يتم منح أرقام قبول مؤقتة من قبل إدارة التسجيل بناء على الطلب المقدم والشهادات المرفقة
- 2- يتم منح الشركات مهلة 18 شهر من تاريخ قبول ملف التسجيل المبدئي لإستكمال باقى ملف التسجيل على ان تكون اول ستة اشهر لاستكمال المستندات الاساسية في ملف التسجيل طبقاً للملحق (2)
- تقوم الشركة خلال الـ 6 شهور الأولى بتقديم ملف التسجيل طبقاً للملحق 2 على الرابط التالي

medevice.edaegypt.gov.eg

بعدها يتم منح الشركة رقم قبول نهائى ثم تمنح الشركة مهلة للاستيراد لمدة عام لحين الانتهاء من اجراءات التسجيل

كما هو متبع في البند 4.1

لن يتم السماح باستيراد خامات و مكونات و مدخلات الإنتاج بعد إنتهاء المهل الممنوحة

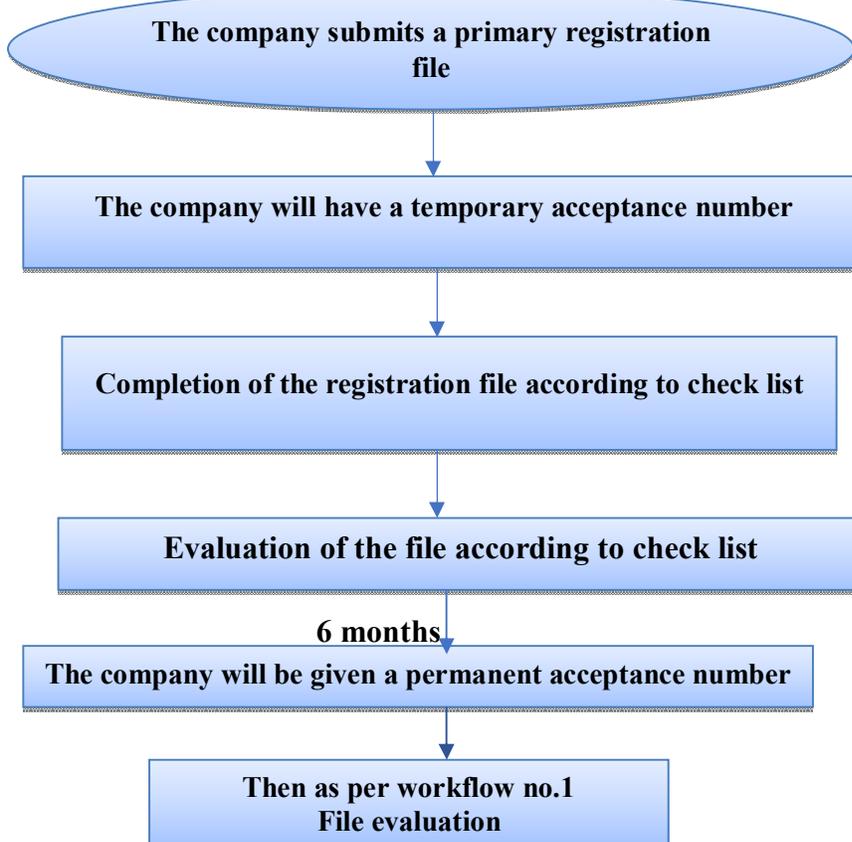Flow Chart (3) of Registration for Medical Devices Class IIa, IIb, III

4.2.3. تسجيل المستلزمات الطبية غير المعقمة كمنظومة واحدة System:

يشترط إعتبار مجموعة من المستلزمات الطبية الغير معقمة انها system و تسجيل برقم تسجيل واحد فى الحالات الآتية:

1. ان يكون لها نفس المصنع القانوني " legal manufacturer "
2. ذكر إحدى الشهادات (declaration of conformity , CE certificate , free sale , CFG certificate from USFDA ,) ان المستلزمات الطبية المقدمة هي system .
3. يتم العرض على اللجنة العلمية المتخصصة للتأكد من ان جميع البنود تعمل مكملتها لبعضها لتكون system .
دون الإلتزام ان تكون مشتركة فيما يلى:

Raw material- GMDN-patient population


4.2.4. تسجيل المستلزمات الطبية غير المعقمة بنظام التجميع bundling

يشترط تطبيق نظام الـ bundling على تسجيل المستلزمات الطبية غير المعقمة فى حالة أن المستلزمات تشترك فى الآتى :

1. Same legal manufacturer
 2. Same classification.
 3. Same generic proprietary name.
 4. Common intended use.
 5. Similar or close design.
 6. Be within scope of the permissible variants that may be evaluated from scientific committee.
- دون الإلتزام ان تكون مشتركة فيما يلى:

Raw material- GMDN-patient population

5. الاجراءات والقواعد المنظمة للجان العلمية المتخصصة

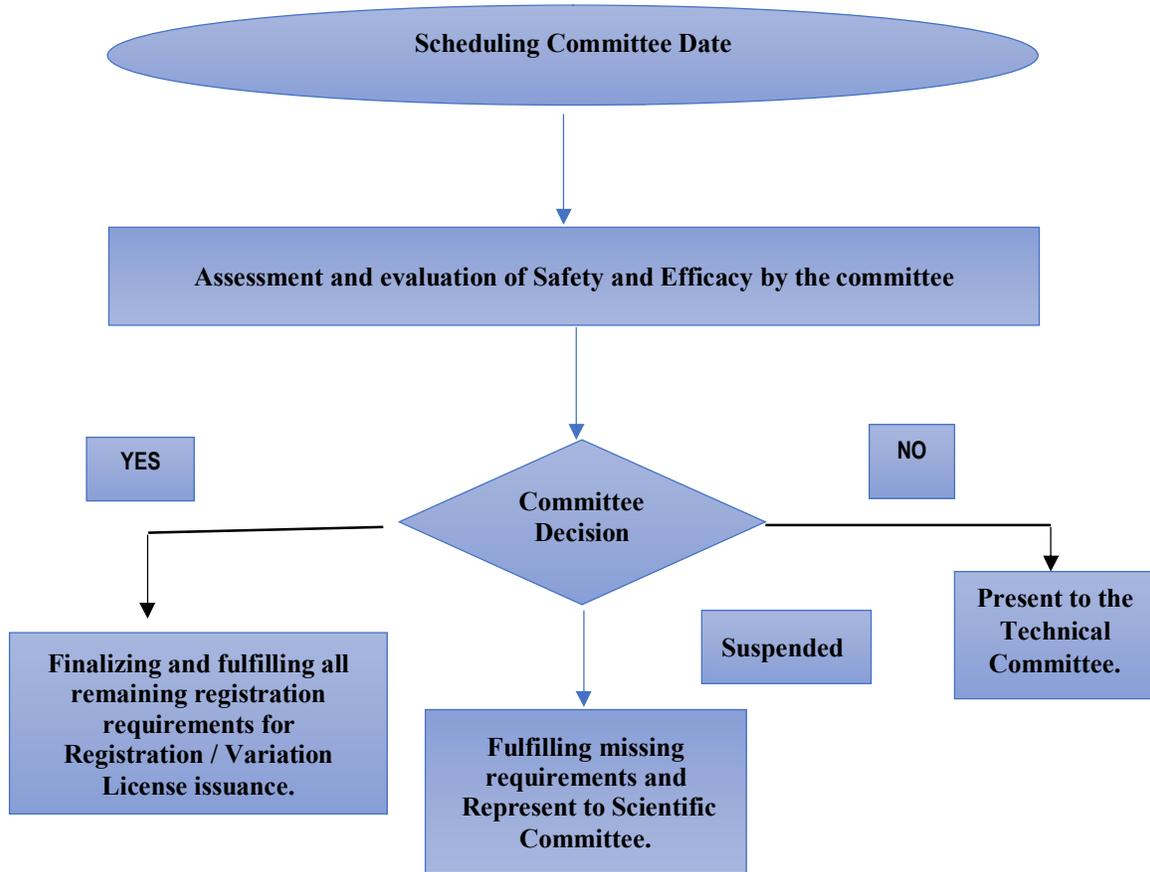Flow Chart (4) of Scientific Committee for Medical Devices

تقسم اللجان العلمية الى تخصصات مختلفة و يتم العرض عليها طبقاً للغرض من استخدام المستلزم او الجهاز الطبي .
المستلزمات التي تخضع للتقييم من قبل اللجان العلمية المتخصصة كخطوة سابقة للتسجيل هي :

- مستلزمات مقدمه للتسجيل الجديد أو إعادة التسجيل مستوردة و وارده من دول غير مرجعية والمحلية .
- مستلزمات مقدمه للتسجيل الجديد أو إعادة التسجيل تعرض للبت لإبداء الرأي عما إذا كانت الفروق بين المستلزمات الطبية هي فروق جوهرية تستدعي تسجيل هذه المستلزمات الطبية منفصلة من عدمه
- مستلزمات طبية في صورة dosage form لتقييم النقاط التالية :
- Safety & effectiveness
- OTC or Prescription
- claims on label and intended use in IFU
- مستلزمات مقدمة للتسجيل الجديد أو إعادة التسجيل وصدر لها تقرير من إدارة مأمونية المستلزمات الطبية انتهى إلى التوصية بالعرض على اللجنة العلمية للتقييم وإبداء الرأي في تقارير المأمونية الخاصة بها أو إستدعي تقييم التقرير الصادر من إدارة مأمونية المستلزمات الطبية العرض على اللجنة العلمية .
- مستلزمات طبية معروضة على اللجنة العلمية لإستيضاح بعض النقاط الفنية

خطوات العمل :

- تحويل الموضوعات التي تتطلب العرض على اللجنة المختصة بتسجيل المستلزمات الطبية / الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية لإتخاذ اللازم.
- انعقاد اللجنة وعرض الموضوعات بالإضافة الى العينات على الأعضاء للدراسة و إبداء الرأي العلمي .
- اصدار القرارات النهائية بشأن كل موضوع تم عرضه (موافقة/تأجيل مسبب /رفض مسبب)
- في حالة التأجيل يتم استيفاء المطلوب عبر المنصة medevice.edaegypt.gov.eg ثم إعادة العرض على اللجنة العلمية

* يتم مراعاة الاتي للمستلزمات الطبية الاتية:

Medical device name / category	Prerequisites
التخدير Anesthesia	
Infusion, I.V. Set & Administration Set	-Must have safety rubber, Injection Port or Latex. -Must have needle. Can be with or without vent (يمكن أن تكون مصحوبة بفتحة تهوية أو بدون) - Must be not less 110cm in length. -يجب أن تكون العبوة بها مكان مخصص لسهولة الفتح
Infusion Sets with Burette	infusion set with burette must contain safety rubber
CVC (Central Venous Catheter not peripheral / central Line Catheter / Infusion Catheter)	Need to have guiding syringe (guiding Y- connector) (ممر أو فتحة جانبية في الإبرة لدخول ال -guiding wire - سرنجه منقوبه - إبره مزدوجه الحقن)
suction catheters	Need to be without any side holes to do not to obstruct suction procedure.
I.V Cannula	Must have side pore (injection port) for drug injection unless for sizes 24 and 26 as they are used for neonates and children Sample from each cannula size has to be presented to the scientific committee.
Extension Lines	Has to state whether Venous or Arterial
Breathing Circuit, Oxygen Mask & Nebulizer	Can be Sterile or Non-Sterile but has to be stated on packaging.
disposable anesthesia breathings circuits	ضرورة أن تشمل ال disposable anesthesia breathings circuits على كافة الأجزاء الضرورية لإستخدامها في الآتى: *في حالة ال y circuit ضرورة تواجد الأجزاء التالية : (water trap+ Breathing bag+3rd limb+CO2 extension) *في حالة ال co axial circuit ضرورة تواجد الأجزاء التالية: (Breathing bag+3rd limb+CO2 extension) داخل عبوة واحدة للأسباب التالية : Avoid connection/ reconnection risks to avoid reuse of part
Endotracheal Tube	- Accept CUFFED for all sizes. - Accept UN CUFFED only for sizes up to and including 5mm. (eg.3, 4 & 5 mm which are used for pediatrics). يتم عرض ال Cuffed & Un Cuffed Tracheostomy Tubes على لجنة الانف والاذن والحنجرة للإختصاص .

Endocrinology الغدد الصماء	
Insulin Pen Needles	وجوب عرض الغلاف الخارجي لل pen needles الذي يذكر جميع أنواع الأقلام المتوافقة التي تستخدم معه على اللجنة العلمية وذلك استناداً لل ISO 11608-2:2012 التي توجب إضافة أسماء الأقلام التي تستخدم مع السنون على ال labels.
insulin syringes	عدم قبول تسجيل insulin syringe EXCEPT the 1ml (100 I.U)
Ear Nose & Throat (E.N.T.) الأنف والأذن والحنجرة	
Tracheostomy Tubes	يتم عرض Cuffed & Uncuffed Tracheostomy Tubes على لجنة الأنف والأذن والحنجرة وليس التخدير. ويتم قبول تسجيل ملفات ال tracheostomy tubes uncuffed & cuffed بجميع المقاسات وذلك لدواعي استخدامها في جراحات الأنف والأذن والحنجرة والتي تختلف كلياً عن استخدامها من قبل أطباء العناية المركزة.
Ear products class I non sterile	يتم تقديم طلبات استعلام من الشركات المستوردة لها متضمنة الآتي: Soft and hard copy of: Trade name, Class, Product category, Manufacturer name, country of origin, Intended Use, Composition, Mechanism of action, packaging, labeling and instructions for use يتم إجراء الآتي: - العرض على لجنة الفارماكولوجي لتقييم وجود تأثير فارماكولوجي للمنتج من عدمه. وفي حالة عدم وجود تأثير فارماكولوجي يتم العرض على اللجنة العلمية المتخصصة لأمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة لتقييمه باعتباره في صورة dosage form ويسمح باستقبال ملف التسجيل الخاص بالمستلزم في حالة موافقة اللجنة العلمية واحاطة اللجنة المختصة بتسجيل المستلزمات الطبية. - أما في حالة وجود تأثير فارماكولوجي له يتم العرض على اللجنة المختصة بتسجيل المستلزمات الطبية.
Nasal dosage form class I non sterile	يتم تقديم طلبات استعلام من الشركات المستوردة لها متضمنة الآتي: Soft and hard copy of: Trade name, Class, Product category, Manufacturer name, country of origin, Intended Use, Composition, Mechanism of action, packaging, labeling and instructions for use ويتم إجراء الآتي: - العرض على لجنة الفارماكولوجي لتقييم وجود تأثير فارماكولوجي للمنتج من عدمه. وفي حالة عدم وجود تأثير فارماكولوجي يتم العرض على اللجنة العلمية المتخصصة لتقييمه باعتباره في صورة dosage form ويسمح باستقبال ملف التسجيل الخاص بالمستلزم في حالة موافقة اللجنة العلمية واحاطة اللجنة المختصة بتسجيل المستلزمات الطبية. - أما في حالة وجود تأثير فارماكولوجي له يتم العرض على اللجنة المختصة بتسجيل المستلزمات الطبية.
Hematology أمراض الدم	
Transfusion Set	Standard filter mesh size ranges from 170-200µ and has to be mentioned on the package.
Apheresis Kit	ذكر العبارة الآتية على الغلاف الخارجي (وحدة البيع) بالإضافة إلى النشرة الداخلية لجميع ال Apheresis Kist فيما يخص المدة التي يتم خلالها استخدام ال kit: "To be used within (.....) after opening the primary package "
Syringes	- إلزام الشركات بوصف المراحل العمرية على الغلاف الخارجي الخاص بالسررنجات بالإسم العلمي حيث يتم ذكر Neonates وليس Baby للفئة العمرية 0-28 days وذلك استناداً


	لتعريف منظمة الصحة العالمية للفئات العمرية. -يتم إحضار عينه من جميع الفئات العمرية المختلفة (Pediatric, Adults etc.) للسرنجات المطلوب تسجيلها.
Interventional & Diagnostic Radiation الأشعة التداخلية والتشخيصية	
Core Biopsy Needles	يتم العرض على لجنة الأشعة التداخلية والتشخيصية
Angiographic Catheter	ضرورة تحديد إذا كانت compatible with lipiodol or not على العبوات الخاصة بالمستلزم في حالة المستلزمات محلية الصنع أو ذكرها في ال IFU or labels في حالة المستلزمات المستوردة.
Urology المسالك البولية	
Any product presented for Re-Registration	يجب احضار تقارير مأمونية من الأماكن التي تم التوريد إليها في الثلاث سنوات الأخيرة.
IIb, III & Implantable Medical Devices presented for New Registration	يتم احضار أي من الآتي- Long- term Scientific Papers on Safety & Efficacy & Clinical Trials published in reputable journals وأفضلية إحضار سابقة أعمال تعدد بها اللجنة (الأماكن التي سبق استخدام المستلزم فيها) في دول مرجعية مع عدم وجوبها. أو أن يكون المستلزم تم انتاجه في شركة دولية لها سمعتها الجيدة في السوق الدولي.
Urine Collection Bags	يجب أن يتم ذكر وتحديد بوضوح على العبوة إذا كانت معقمة ام غير معقمة والتفريق بينهم باللون
Surgery الجراحة العامة	
Surgical Sutures	بخصوص الخيوط الجراحية: -الواردة من دول غير مرجعية: -يتم اجراء اختبار tensile strength لمقاس واحد من كل خيط جراحي قبل وبعد التسجيل (تسجيل جديد/اعادة) وضرورة اثباته في التقارير الواردة من الادارة المركزية للرقابة الدوائية بالإضافة الى الاختبارات الاخرى التي تقوم بها الادارة المركزية للرقابة الدوائية على أن يتم عرض التقارير الواردة خلال السير في اجراءات التسجيل على اللجنة العلمية المتخصصة للجراحة العامة وجراحة التجميل. - الواردة من دول مرجعية: فيما يخص الخيوط الجراحية المقدمة للتسجيل (تسجيل جديد/اعادة) يتم اجراء هذا الاختبار عليها بعد التسجيل لمقاس واحد فقط من نوع خيط جراحي محل طلب التسجيل وضرورة اثباته في التقارير الواردة من الادارة المركزية للرقابة الدوائية بالإضافة الى الاختبارات الاخرى التي تقوم بها الادارة المركزية للرقابة الدوائية.
DermaI Fillers	*وضع التحذير الآتي في مكان واضح على العبوة الخارجية على جميع ال Dermal Filler: 1- يمنع حقن المستلزم في الاوعية الدموية. 2- يتم استخدام هذا المستلزم عن طريق اطباء المرخص لهم فقط. *يتم تطبيق التوصيات الصادرة من اللجنة العلمية المتخصصة للجراحة العامة وجراحة التجميل بخصوص dermaI fillers بشأن الآتي: - إضافة ال ID الخاص بالمستلزم داخل العبوة والذي يحدد ال batch number حتى يتسنى للطبيب المعالج تتبع وتحديد المستلزم المستخدم للمريض في حالة حدوث أي مضاعفات. على أن تلتزم الشركات المستوردة لل dermaI fillers بالاحتفاظ بسجلات التشغيلات التي تم توزيعها لأماكن التوريد المتضمنة جميع بيانات المستخدمين وفقاً لنظام التتبع (recall system) الخاص بكل شركة ليتسنى للادارة المركزية للعمليات متابعتها. - في حالة ذكر أن dermaI filler له corrective action في النشرة الداخلية فانه

	يستوجب احضار دراسات علمية منشورة في مجلات علمية عالمية يعتد بها لإثبات وتوضيح ال corrective action
Sterile Dressings	يتم اضافة عبارة (جميع الغيارات تستخدم تحت إشراف طبي) على وحدة البيع الخاصة بالغيارات المعقمة على أن يتم متابعة تطبيق هذا القرار من خلال الادارة المركزية للعمليات.
Stainless steel Sutures	Stainless Steel Suture is used only in STERNUM. عدم السماح بذكر الاستخدام الآتي في دواعي الاستخدام: "Abdominal Wound Closure, Intestinal anastomosis & Hernia Repair"
2 Rows Staplers	يتم استقبال ملفات تسجيل جديد/ اعادة تسجيل ل Open surgery, Linear or Articulating 2 double staggered rows staplers + their reloading units على أن يتم عرضها على اللجنة العلمية المتخصصة للجراحة العامة وجراحة التجميل سواء واردة من دول مرجعية أو غير مرجعية لابداء الرأي العلمى فيها وفى حالة موافقة اللجنة العلمية عليها يتم السير فى اجراءات التسجيل. - تحديد موقف الـ reloading units الخاصة بالديباسات قبل العرض على اللجنة العلمية. - تحديد اذا كانت الديباسات تستخدم في الـ endoscopic surgeries أو الـ open surgeries قبل العرض على اللجنة العلمية. - تحديد إذا كانت الديباسات skin staplers من عدمه من قبل الشركة وعلى ورق الشركة قبل العرض على اللجنة العلمية
Orthopedics طب العظام	
Implantable Sterile Medical Products	1- عرض شهادة Free Sale, CE& ISO 13485 مع تقديم سابقة اعمال للمستلزم من دولة مرجعية وكذلك تقديم Long-Term Scientific Papers On Safety & Efficacy & Clinical Trials Published In Reputable Journals 2- احضار اختبارات على المستلزمات المراد تسجيلها فى أحد المعامل المعتمدة من International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) - بالاضافة الى اجراء الاختبارات بأى من كليات الهندسة و تقييمها من قبل اللجنة العلميه
Implantable Non-Sterile Medical Products	- احضار اختبارات (وفقا لمواصفة التصنيع) على المستلزمات المراد تسجيلها فى أحد المعامل المعتمدة من International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) بالاضافة الى اجراء الاختبارات بأى من كليات الهندسة وتقييمها من قبل اللجنة العلميه. يتم استثناء المستلزمات الطبية التى لها مصنع قانونى فى دولة مرجعية ومصنع فعلى فى دولة غير مرجعية من تقديم الآتى: - سابقة اعمال للمستلزم من دولة مرجعية وكذلك تقديم Long-Term Scientific Papers on Safety & Efficacy & Clinical Trials Published In Reputable Journals - اختبارات على المستلزمات المراد تسجيلها فى أحد المعامل المعتمدة من (International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) و تقييمها من قبل اللجنة العلمية. - اختبارات كلية الهندسة .

طب العيون Ophthalmology	
Ophthalmic Sutures from Non - Reference country	اجراء اختبار tensile strength لجميع مقاسات Ophthalmic Sutures قبل وبعد التسجيل (تسجيل جديد/اعادة) وضرورة اثباته في التقارير الواردة من الادارة المركزية للرقابة الدوائية بالإضافة الى الاختبارات الأخرى التي تقوم بها الادارة على أن يتم عرضها على اللجنة العلمية المتخصصة لأمراض وجراحة العيون .
Trypan blue	يتم استقبال ملفات تسجيل للمستلزمات التي تحتوي على TRYPAN BLUE بتركيز لا يتجاوز 0.06% وان تكون دواعي استخدامها في جراحات المياه البيضاء والجزء الامامي من العين.
Ectoin	لا يتم استقبال ملفات تسجيل جديد/اعادة تسجيل تحتوي على مادة الـ Ectoin
طب القلب Cardiology	
Silk Suture without needles	استقبال Silk Suture without needles لاستخدامه من قبل المتخصصين في مجال جراحة القلب و الأوعية الدموية في مجالات عديدة على سبيل المثال لا الحصر، في ربط الانابيب أثناء العمليات الجراحية.
مستلزمات أخرى	
Oral dosage form class I non sterile	يتم تقديم طلبات استعلام من الشركات المستوردة لها متضمنة الآتي: Soft and hard copy of: Trade name, Class, Product category, Manufacturer name, country of origin, Intended Use, Composition, Mechanism of action, packaging, labeling and instructions for use ويتم اجراء الآتي: - العرض على لجنة الفارماكولوجي لتقييم وجود تأثير فارماكولوجي للمنتج من عدمه. وفي حالة عدم وجود تأثير فارماكولوجي يتم العرض على اللجنة العلمية المتخصصة لتقييمه باعتباره في صورة dosage form ويُسمح باستقبال ملف التسجيل الخاص بالمستلزم في حالة موافقة اللجنة العلمية واحاطة اللجنة المختصة بتسجيل المستلزمات الطبية. أما في حالة وجود تأثير فارماكولوجي له يتم العرض على اللجنة المختصة بتسجيل المستلزمات الطبية.
Obesity products	يتم تقديم طلبات استعلام من الشركات المستوردة للمستلزمات التي تستخدم لعلاج السمنة ويتم تصنيفها كمستلزم طبي في بلد المنشأ ويتم عرضها على اللجان المختصة قبل البت في موقفها من التسجيل

6. الاجراءات والقواعد المنظمة للجنة العلمية المتخصصة لتقييم دراسات الثبات والتوافق الحيوي (biocompatibility)

Flow Chart (5) of Stability Committee for Medical Devices

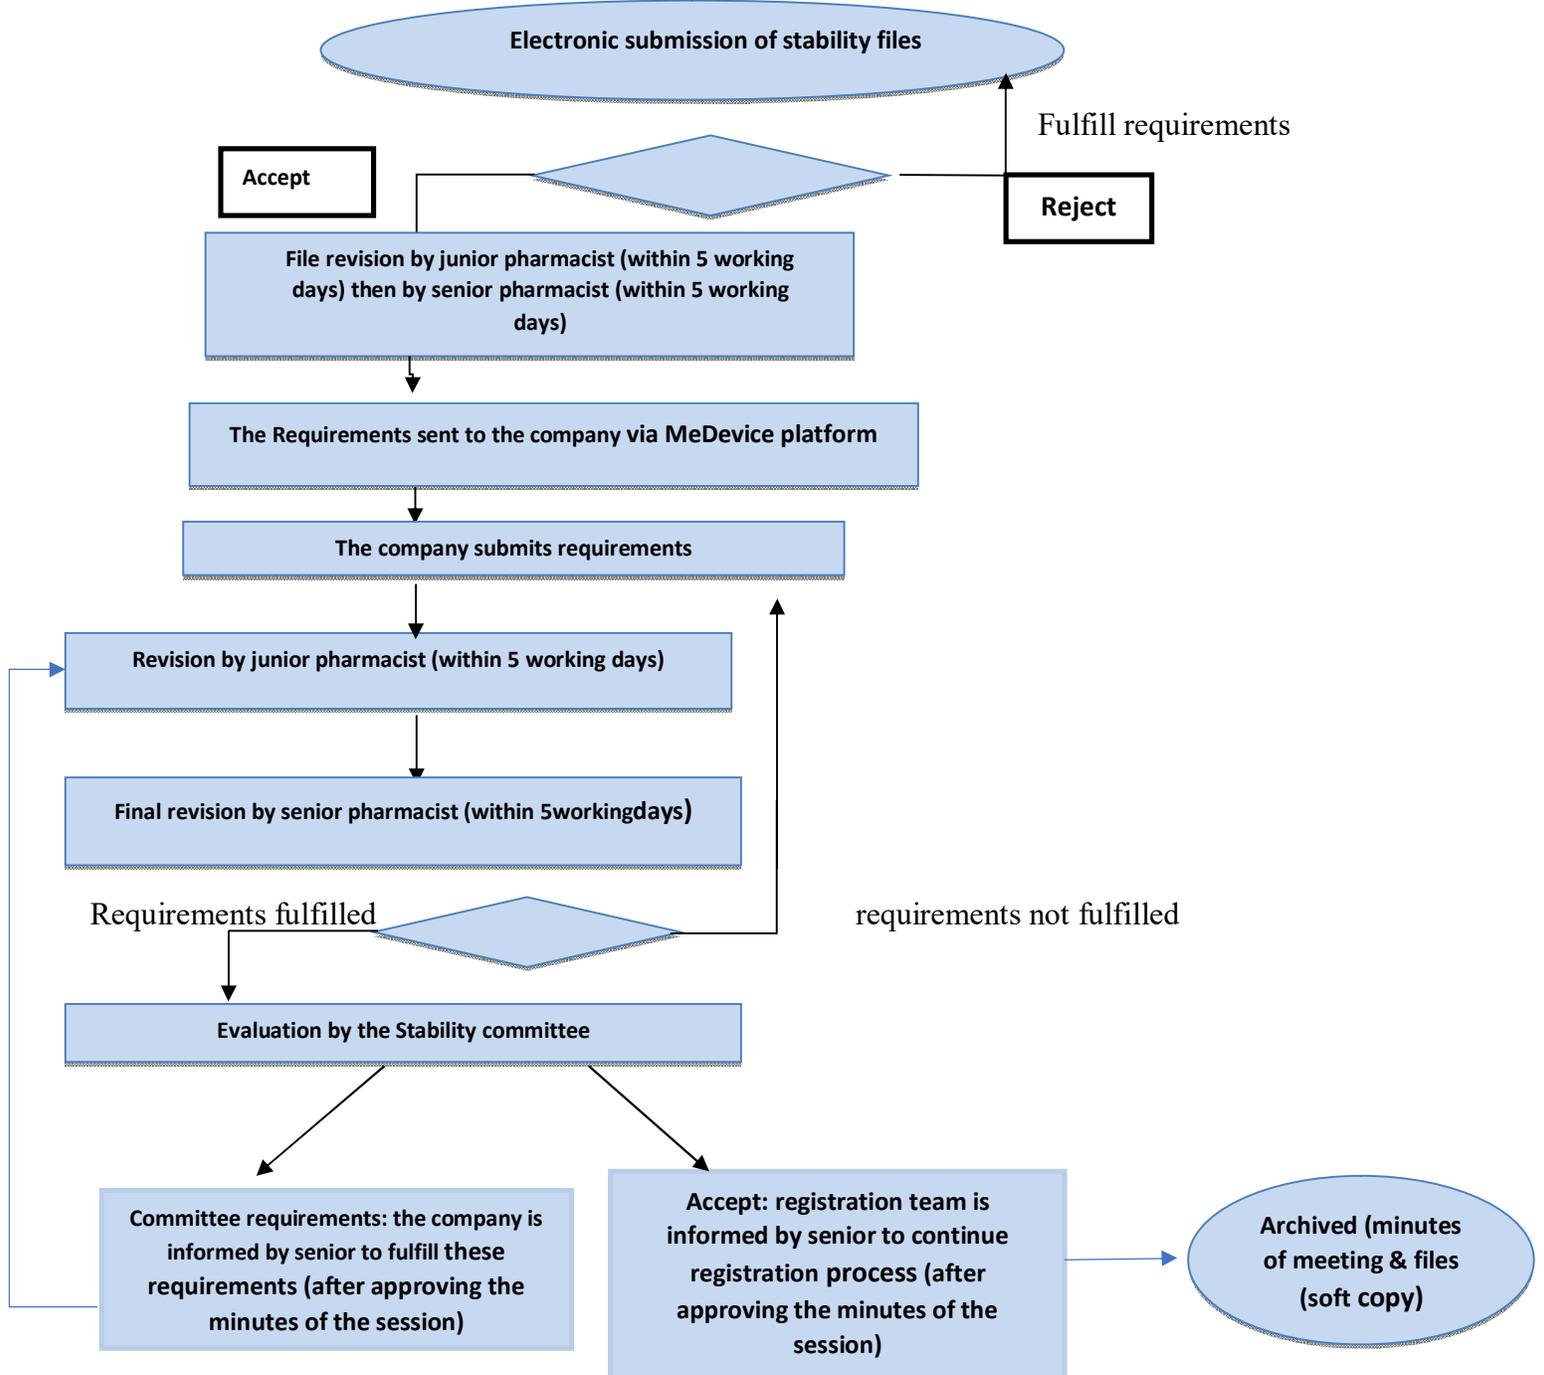

- يتم العرض على اللجنة العلمية المتخصصة لتقييم دراسات الثبات والتوافق الحيوي (biocompatibility) في حالة:
- 1- المستلزمات الطبية محلية الصنع المقدمة للتسجيل أو إعادة التسجيل والغير متداولة في إحدى الدول المرجعية (أي غير حاصلة على شهادة free sale certificate من إحدى الدول المرجعية أو الغير حاصلة على شهادة 510K (FDA Clearance)
 - 2- المسجلة والمقدمة لقسم المتغيرات لتعديل (تغيير أو اضافة عبوة- تغيير أو اضافة طريقة تعقيم – تغيير ظروف تخزين)
 - 3- مد مدة صلاحية مستلزم طبي (إعادة تسجيل / متغيرات)
 - 4- المستلزمات المسجلة والمقدمة لقسم المتغيرات لتصحيح مدة الصلاحية نتيجة وجود خطأ في شهادة مدة الصلاحية المقدمة من الشركة

خطوات العمل:

- 1- يتم تقديم الملف على المنصة medevice.edaegypt.gov.eg طبقاً لـ check list (ملحق 5)
- 2- يتم قبول ملف الثبات في حالة استيفاء الملف لكافة البنود المذكورة بال Check list
- 3- يتم تقييم ملف الثبات خلال 10 أيام عمل.
- في حالة وجود إستيفاءات يتم تقديمها على المنصة medevice.edaegypt.gov.eg ويتم مراجعتها والرد على طالب التسجيل خلال 5 أيام عمل من تاريخ الإرسال.
- 4- بعد إنهاء جميع الإستيفاءات يتم عرض الملف على اللجنة العلمية المتخصصة لتقييم دراسات الثبات (biocompatibility) الخاصة بالمستلزمات الطبية.
- 5- في حالة موافقة اللجنة يتم إستكمال اجراءات التسجيل و في حالة وجود مستندات مطلوبة يتم إحاطة الشركة

*اشتراطات عامة بخصوص اللجنة العلمية المتخصصة لتقييم دراسات الثبات:

أولاً: عند قيام المصانع المحلية بعرض دراسة الثبات الخاصة بأى مستلزم طبي للتقييم من قبل اللجنة العلمية المتخصصة لتقييم دراسات الثبات (Biocompatibility) الخاصة بالمستلزمات الطبية، يتم الالتزام بتقديم الآتي:

- ضرورة عرض دراسات ثبات المستلزمات الطبية المحلية التصنيع على اللجنة العلمية المتخصصة لدراسة الثبات مرفقا بها عينات محرزة من قبل الادارة المركزية للعمليات ومختومة من الجهة التي قامت باجراء الدراسة (المصنع/معمل معتمد) على أن يتم الاحتفاظ بتلك العينة في المصنع طوال فترة سريان اخطار تسجيل المستلزم الطبي ،ومتابعة ذلك من خلال الادارة المركزية للعمليات مع إلزام المصنع بتقديم تلك العينة مثبت عليها lot number مطابق للمذكور بدراسة الثبات المقدمة للعرض على اللجنة العلمية المتخصصة لتقييم دراسات الثبات (Biocompatibility) الخاصة بالمستلزمات الطبية.
- على أن يتم تطبيق هذا القرار على دراسات الثبات التي تم اجراؤها بعد 2/1/2018
- محضر التحريز المرفق بالعينة المحرزة من قبل الادارة المركزية للعمليات.
- نموذج ال checklist الصادر من الادارة المركزية للعمليات والذي تم تطبيقه على معمل المصنع الذي تم اجراء دراسة الثبات به.

ثانياً: وجوب تقديم Real time stability study للمستلزمات الطبية المقدمة لاعادة التسجيل.

ثالثاً: فيما يخص ظروف التخزين المذكورة على الغلاف الخارجي للمستلزمات الطبية محلية التصنيع:

i. يتعين تقديم دراسات ثبات تم إجراؤها عند ظروف تخزين $30 \text{ C}^{\circ} \pm 2, \text{RH } 65 \pm 5\%$ حيث ان جمهورية مصر العربية تقع في نطاق Zone IVa

ii. فيما يخص ظروف التخزين المذكورة على الملصقات الداخلية للمستلزم الطبي يتعين على المصنع وضع علامة استرشادية على

الlabel الخاص بالمستلزم الطبي توضح ان الحد الأقصى لتخزين المستلزم الطبي هو 30° أو اثبات الآتي بصورة واضحة على الlabel الخاص بالمستلزم الطبي (Upper limit of temperature= 30°)

iii. في حالة رغبة المصنع في وضع علامة استرشادية  توضح (upper and lower limits of temperature) يتعين على المصنع تقديم ما يفيد ثبات المستلزم الطبي عند درجات الحرارة المذكورة بالعلامة الاسترشادية .

iv. يتعين على المصنع الإلتزام بتخزين المستلزم الطبي عند ظروف التخزين المشار إليها على الملصقات الداخلية للمستلزم الطبي والمرفقة باخطار التسجيل ويتم متابعة تخزين المستلزم الطبي عند تلك الظروف من خلال الإدارة المركزية للعمليات.

رابعاً: في حالة عدم توافر إمكانية إجراء دراسة الثبات أو بعض الاختبارات يمكن للشركة إجراء الاختبارات لدى جهة معتمدة لذلك على ان يتم تقديم شهادة تأهيل/ اعتماد جهة اصدار دراسة الثبات طبقاً للمواصفة القياسية العالمية ISO-17025 الصادرة من جهة الاعتماد مع التقدم بما يثبت ان **the scope of accreditation** لهذه الجهة يتضمن اعتمادها لإجراء الاختبارات المقدمة وتكون نتائج هذه الاختبارات تحت مسؤولية الشركة المنتجة ويمكن ادراج نتائج هذه الاختبارات كجزء من دراسة الثبات للمنتج.


خامساً: يتعين إجراء دراسة ال **Biocompatibility** لدى جهة معتمدة لذلك على ان يتم تقديم شهادة تأهيل/ اعتماد جهة اصدار الدراسة طبقاً للمواصفة القياسية العالمية ISO-17025 الصادرة من جهة الاعتماد مع التقدم بما يثبت ان **the scope of accreditation** لهذه الجهة يتضمن اعتمادها لإجراء الاختبارات المقدمة وتكون نتائج هذه الاختبارات تحت مسؤولية الشركة المنتجة

سادساً: يجب تحديد طريقة التعقيم للمستلزم الطبي الذي يتم اختباره في جميع الدراسات الخاصة باختبارات ال **Sensitization & Irritation**

سابعاً: إعفاء المستلزمات الطبية المقدمة لقسم المتغيرات الواردة من دول مرجعية من تقديم **Biocompatibility Study** عند العرض على اللجنة العلمية المتخصصة لتقييم دراسات الثبات (**Biocompatibility**) الخاصة بالمستلزمات الطبية.

7. اجراء اللجنة المختصة بتسجيل المستلزمات الطبية

Flow Chart (6) of specialized committee on registration of medical devices

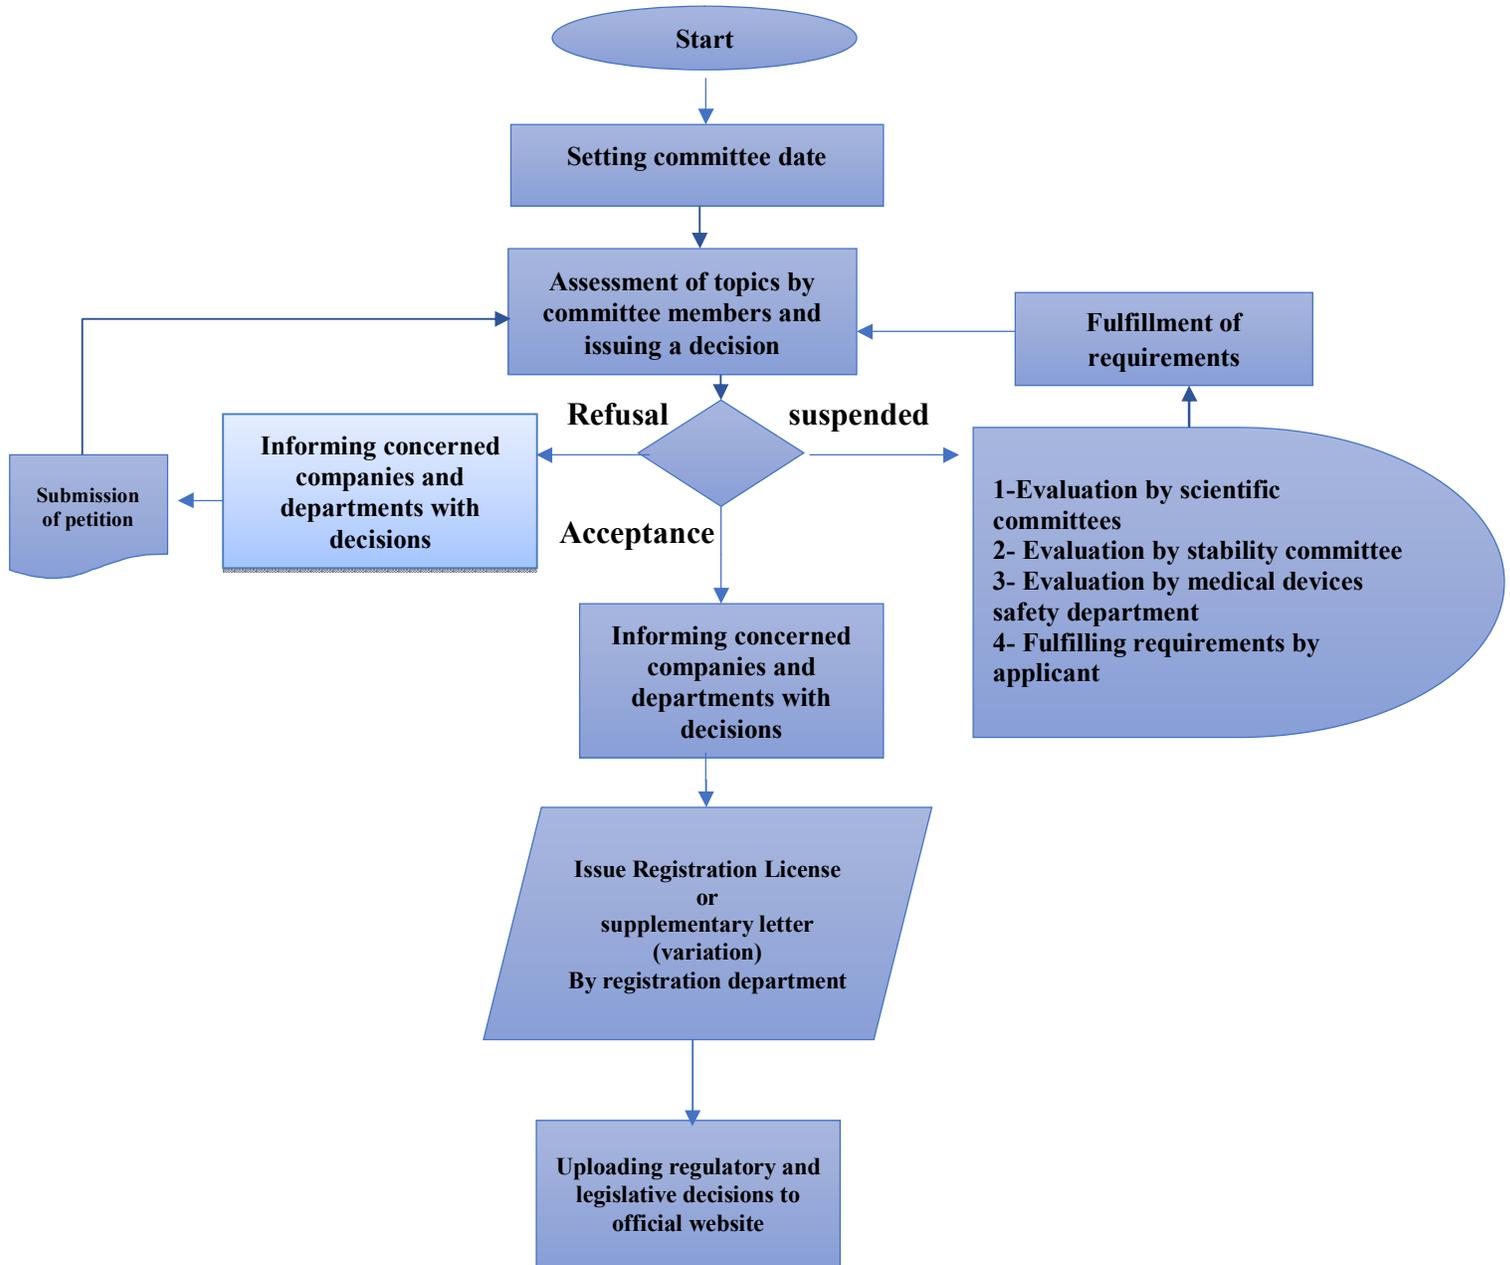

8. مأمونية المستلزمات الطبية :

يتم تقديم ملف لإدارة المأمونية في الحالات التالية فقط:

- المستلزمات الطبية المصنفة class I Ib, III والمستلزمات الطبية المصنفة I , IIa التي لها regulatory actions وذلك للمستلزمات الطبية:
- المستوردة المقدمة إلى التسجيل/ إعادة التسجيل
- المحلية المقدمة لإعادة التسجيل

كما يتم تقديم تعهدات مأمونية من الشركة المصنعة في الحالات التالية:

- المستلزمات الطبية المستوردة والمقدمة إلى التسجيل أو إعادة التسجيل والمستلزمات الطبية المحلية المقدمة لإعادة التسجيل بجميع تصنيفاتها

*تلتزم الشركة المستوردة في حالة طلب تسجيل / إعادة تسجيل بتقديم تعهد بوجود نظام يقظة المستلزمات الطبية وبمتابعة جميع أنشطته ومتطلباته وفقاً للدلائل الاسترشادية لنظام يقظة المستلزمات الطبية مع إدارة مأمونية المستلزمات الطبية- مركز اليقظة الصيدلانية المصري .

*تلتزم الشركة بالإبلاغ عن أي إجراءات سحب (Recall) أو FSN أو FSCA تتم عالمياً أو أي حوادث incidents يتم رصدها في جمهورية مصر العربية لإدارة مأمونية المستلزمات الطبية- مركز اليقظة الصيدلانية المصري، وفقاً للمدد الزمنية المحددة بالدلائل الاسترشادية لنظام يقظة المستلزمات الطبية.

نماذج تعهدات المأمونية (ملحق6)

9. إصدار إخطار التسجيل:

بعد إستيفاء ملف التسجيل و سداد الرسوم ومقابل الخدمات يتم إصدار اخطار التسجيل للمستلزم ساري لمدة 10 سنوات

10. إجراءات إعادة التسجيل:

- يتم إعادة تسجيل المستلزمات الطبية كل 10 سنوات بناءً على طلب يُقدم إلى الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية ويشترط القبول المبني للطلب خلال الـ 3 شهور الأولى من العام الأخير من صلاحية إخطار التسجيل.
- يلتزم مقدم الطلب بتقديم ملف إعادة التسجيل طبقاً لقائمة المستندات المطلوبة.
- يتم تحصيل مقابل الخدمات طبقاً للقرار الصادر من رئيس هيئة الدواء في هذا الشأن.
- بالنسبة للمستلزمات الطبية محلية الصنع والمستلزمات الطبية الواردة من دول غير مرجعية لا يتم إعادة التقييم عند إعادة التسجيل من اللجان العلمية في حالة ورود تقارير من إدارة المأمونية تفيد بقبول المستندات وعدم حدوث إجراءات رقابية خاصة بالمستلزم مع عدم وجود أي تعديل في المستلزم المسجل من حيث بيان التركيب -الاستخدام-التصميم-التصنيف
- بالنسبة للمستلزمات الطبية محلية الصنع الخاضعة للعرض على اللجنة العلمية لتقييم دراسات الثبات :
 - < لا يتم العرض على اللجنة العلمية لتقييم الثبات في حالة عدم حدوث أي تعديل في مواد الخام للعبوة وفي حالة تقديم real time stability study عند التسجيل اول مرة أو خلال مدة سريان الاخطار.
 - < في حالة عدم تقييم الـ real time stability study عند التسجيل اول مرة أو خلال مدة سريان الاخطار يتم تقييمها عند إعادة التسجيل .
 - < في حالة وجود تغيير في المواد الخام: يتم إعادة تقييم biocompatibility study من اللجنة العلمية للثبات
 - < في حالة تغيير طريقة التعقيم : يتم إعادة تقييم الاتي من قبل اللجنة العلمية لتقييم دراسات الثبات:

New stability study including sterilization validation only and re-evaluation of biological risk assessment

← في حالة تغيير في **packaging material** او **packaging dimension** يتم إعادة تقييم الاتي من قبل اللجنة العلمية لتقييم دراسات الثبات:

New stability study including packaging validation only and re-evaluation of biological risk assessment

← في حالة تغيير مدة الصلاحية و / أو ظروف التخزين : يتم تقييم الاتي من قبل اللجنة العلمية لتقييم دراسات الثبات:

New stability study and re-Evaluation of biological risk assessment

يلتزم مقدم الطلب بإنهاء إجراءات إعادة التسجيل خلال عام من تاريخ انتهاء مدة صلاحية اخطار التسجيل، ويُسمح له بالتداول خلاله، وعند انتهاء هذه المدة وعدم استيفاء متطلبات الملف النهائي لإعادة التسجيل يعتبر الطلب كأن لم يكن ويتم إبلاغ الإدارة المركزية للعمليات ، و يجدد الطلب بناء على طلب رسمي مقدم من الشركة و إعادة تسديد رسوم التسجيل و يتم إعادة قبول الملف و يمنح عام لاستكمال متطلبات إعادة التسجيل .

11. إشتراطات عامة :

1. شروط تسجيل المستلزم الطبي كمستلزم طبي برقم تسجيل واحد هي أن تكون مشتركة في الأتي:
الاسم التجاري، GMDN or UMDN Code، التصنيف، الاستخدام، المصنع، بيان التركيب و الفئة العمرية (فيما عدا اختلاف المقاسات)
لا يتم فصل الخيوط الجراحية في حالة اختلاف بيان تركيبها وتمنح اخطار تسجيل واحد.
- في حال وجود اختلاف عما سبق يتم تسجيل المستلزمات الطبية كمستلزمات طبية منفصلة و يمنح كل مستلزم إخطار تسجيل منفصل برقم تسجيل منفصل.
2. في حالة المستلزمات الطبية المشتركة فيما سبق والمختلفة في أي فارق اخر يتم عرض المستلزمات على اللجنة العلمية المتخصصة لدراسة هذه الفروق و تحديد هل الفروق تعتبر فروق جوهرية أم غير جوهرية و من ثم فصل المستلزمات وتسجيل كل مستلزم على حدة .
3. شروط تسجيل مستلزمات العظام كمنظومة واحدة **system**:
▪ يطبق على المفاصل والمسامير و الشرايح
▪ أرفاق الـ Catalogue الأصلي المُقدم من الشركة في ملف التسجيل، و ذلك للتأكد من مطابقة الاجزاء المراد تسجيلها كـ System واحد بالـ Catalogue وكذلك التقدم من جانب الشركة المنتجة بما يفيد بأن الاجزاء المراد تسجيلها هي اجزاء لـ System واحد وذلك استنادا لقرار اللجنة العلمية المتخصصة لأمراض و جراحة العظام.
▪ يتم عرض كل مستلزم مقدم للتسجيل على حده على اللجنة العلمية المتخصصة لأمراض و جراحة العظام.
▪ اعتبار المستلزمات الطبية المقدمة للتسجيل انها system بناء على شهادة CE design examination certificate او شهادة التداول الحر او شهادة الـ FDA، على ان تذكر الاجزاء المكونة لكل system بأكوادها بوضوح في شهادة التداول الحر او الـ FDA
4. اصل رخصة التسجيل ملك لصاحبها ولا يعتد بأي صورة مع وكيل/موزع آخر.
5. لا يجوز اجراء اي كشط او تغيير في بيانات اخطار التسجيل والا يعتبر لاغي.
6. المستلزمات الطبية التي تؤخذ من خلال oral/nasal/auricular route يتم تحليلها أثناء السير في اجراءات تسجيلها.
7. مدة ترخيص التسجيل تنتهي بعد عشر سنوات من تاريخ التسجيل ويشترط القبول المبدئي للطلب خلال الـ 3 شهور الأولى من العام الأخير من صلاحية إخطار التسجيل.
8. لا يسمح بالاعلان عن المستلزمات الطبية في اي من وسائل الاعلام الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة المختصة بهيئة الدواء المصرية.
9. يتم اصدار إخطار التسجيل وفقاً لشهادة الجودة الحاصل عليها المُستلزم، المصنع الاجنبي والمستورد مسنولان مسؤولية كاملة عن صلاحية الجهاز والمستلزم وسلامته الفنية وأي عيوب او أخطار تترتب على استخدامه تقع على مسؤوليتهما الخاصة.
10. يتم التعامل مع ادارة التسجيل بموجب تفويض رسمي صادر لممثل الشركة موثق بنكياً (صحة توقيع).
11. لا يجوز إجراء أي تغيير في المستلزم الطبي إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية طبقاً للإجراءات المتبعة حسب نوع المتغير وإلا يلغى اخطار التسجيل.
12. تطبيق ال recall system

13. تلتزم الشركة بتطبيق متطلبات المأمونية.
14. اشتراطات خاصة ببعض المستلزمات الطبية:

Textured Breast Implant	عدم قبول تسجيل اي Textured Breast Implant من دول مرجعية او غير مرجعية وذلك لثبوت خطورته عالمياً وتسببه في حدوث Large cell lymphoma
textured tissue expanders	لا يتم استقبال ملفات تسجيل/ السير في اجراءات تسجيل/ استيراد هذه المستلزمات
Injectable Permanent Soft Tissue Dermal filler	لا يتم استقبال أي "Injectable Permanent Soft tissue Dermal filler" حيث أن نسبة حدوث مضاعفات خطيرة من جراء حقنها عالية جداً مما أدى إلى إجماع العديد من الأبحاث العلمية العالمية على عدم استخدامها لخطورتها.
Laparoscopic 2 rows stapler	عدم استقبال ملفات تسجيل جديد أو إعادة تسجيل لأي Laparoscopic 2 rows staplers التي تستخدم في الجهاز الهضمي.
Surgical Powdered Latex Gloves	لا يتم استقبال ملفات تسجيل جديد من surgical powdered latex gloves
Steel Lancets	عدم استقبال ملفات تسجيل جديدة لأي مستلزم Steel Lancet وذلك لوجود بدائل أسهل وأقل ألماً وأقل عرضه للتلوث لأن المستلزم أعلاه يتسبب في جرح أكبر من الأنواع الأخرى ومريض السكر لا تلتئم جروحه بسهولة
Surgical needle (إبرة بدون خيط)	لا يوجد لها استخدام في الطب الحديث وعند لضمها بالخيط الجراحي تستدعي عمل عقدة تؤدي إلى تهتك الأنسجة.
Syringes without needle (الإبر بدون سرنجات)	- لا يتم استقبال ملفات تسجيل جديد/إعادة تسجيل سرنجات بدون إبر للحقن الوريدي أو العضلي أو تحت الجلد.
Insulin syringes (تدريج 40 أو مزدوجة التدريج)	- لا يتم منح مواعيد أو استقبال ملفات / السير في اجراءات تسجيل سرنجات مزدوجة التدريج . - لا يتم السماح بتسجيل مقاس لسرنجات الانسولين غير مقاس ال100 وحدة

12. قائمة المستندات المطلوبة لتسجيل المستلزمات الطبية و ملاحق الطلبات

ملحق (1) محتويات ملف المستلزمات الطبية المستوردة المقدمة للتسجيل الجديد/إعادة تسجيل معقمة أو غير معقمة

- 1- إيصال دفع رسوم التسجيل/إعادة التسجيل
- 2- اصل التفويض معتمد من رئيس مجلس الادارة مع التصديق البنكي عن التوقيع بالشخص المسنول عن التعامل مع ادارة تسجيل المستلزمات الطبية و استلام اخطارات التسجيل.
- 3- تعهد الالتزام باجراءات الامونية وفقا للأعلان الصادر من مدير عام مركز اليقظة الصيدلانية المصرى و المعتمد من رئيس الإدارة بتاريخ 2018/04/24 و تاريخ 2019/08/08.

4- للشركات يطلب الاتى :

- خطاب موثق لتفويض الشركة المستوردة بالتسجيل مذكور به اسم المستلزم يشمل الاسم التجارى للمستلزم صادر من: المصنع القانونى او من يفوضه المصنع القانونى بموجب علاقة موثقة أو من الشركة الأم او من تفوضه بموجب علاقة موثقة(توضح الشركة الأم و المصنع القانونى و الجهة المسنولة عن إصدار تفويض التسجيل مع توضيح الاسم و العنوان لكلا منهم)
- السجل التجارى المجدد الخاص بالشركة المستوردة و ترخيص القيد لطالب التسجيل.
- او
- ترخيص القيد به اسم الشركة المصنعة او اسم الشركة الموزعة بناء على خطاب العلاقة بين المصنع والمورد
- عقد التوزيع او الوكالة مع المورد الاجنبى مباشرة سارى التاريخ ومحدد المدة ويكون موثقاً
- علاقة المصنع الاجنبى مع الموزع او المورد الاجنبى اذا وجد يتضمن النص صراحة على احقية الشركة الموزعة او المورد الاجنبية فى إبرام العقود و الوكالات الخارجية نيابة عن المصنع موثقة معتمدة

للمكاتب العلمية يطلب الاتى:

- رخصة مكتب علمي
- العلاقة إن وجدت

- المكاتب العلمية التى تسجل مستلزمات طبية من انتاج شركات ليست احد فروع الشركة الام الخاصة بالمكتب العلمى يلزم تقديم الاتى:
- خطاب موثق من المصنع القانونى للمستلزمات الطبية يفوض المكتب العلمى بالتسجيل لها فى مصر
 - خطاب موثق صادر من الشركة الام للمكتب العلمى يفيد بعدم ممانعتها فى قيام الشركة المالكة للمستلزمات الطبية بتفويض المكتب العلمى بتسجيل مستلزماتها فى مصر
 - اصل التفويض معتمد من رئيس مجلس الادارة مع التصديق البنكي عن التوقيع بالشخص المسنول عن التعامل مع ادارة تسجيل المستلزمات الطبية و استلام اخطارات التسجيل.
 - تعهد بالالتزام باجراءات الامونية وفقاً للإجراءات المتبعة بمركز اليقظة الصيدلانية المصرى

2- الشهادات المطلوبة سارية التاريخ لمدة لا تقل عن 3 شهور على الاقل من تاريخ تسليم الملف :

*لا يشترط توثيق شهادات الجودة الخاصة بالمستلزمات الطبية (CFG from FDA, CE), شهادة ISO 13485:2016 او شهادة EN ISO 13485:2016 FRRESALE (-) الصادرة من الدول المرجعية من (الغرفة التجارية و السفارة المصرية ببلد المنشأ) و التى قامت الإدارة بالتحقق من صحتها من الجهات التى تصدر هذه الشهادات. و فى حالة عدم التأكد من صحة صدور هذه الشهادات من تلك الجهات يتم تقديم هذه الشهادات موثقة من الغرفة التجارية و السفارة المصرية و فى حالة عدم رد الجهة فى خلال 3 شهور من تاريخ إستقبال الملف يتم تحويل الملف للحفظ وإعادة تقديمه بعد التوثيق مرة اخرى وفقاً لقائمة المستندات المعلنة وقت إعادة التقديم.

*ملحوظة: لا يشترط توثيق شهادات CFG from USFDA من الغرفة التجارية والسفارة المصرية في حالة التحقق من بيانات المستلزم المذكورة بها وذلك من خلال موقع كل من FDA CDRH Export certificate validation والـ Premarket Notification) 510k للمستلزمات الطبية المصنفة Class II و FDA CDRH Export certificate validation والمستلزمات الطبية المصنفة class III (PMA(Premarket Approval) والـ

(1 شهادة الـ Free Sale صادرة من وزارة الصحة من بلد المنشأ إذا كانت مرجعية (او شهادة تداول من احدي الدول المرجعية إذا كانت بلد المنشأ دولة غير مرجعية) تشمل الاسم التجارى للمستلزم والأكواد او المقاسات و تحتوى على المصنع القانونى و المصنع الفعلى (إن وجد)
OR

(2 شهادة CFG الصادرة من USFDA للمستلزم تشمل الاسم التجارى والأكواد للمستلزمات و تحتوى على المصنع القانونى و المصنع الفعلى (إن وجد)
(في حالة الحصول عليها لا تطلب شهادة CE و لا شهادة ISO13485 فى حالة ذكر شهادة FDA لل Plant at that time appeared to be in compliance with current good manufacturing practice requirements

(3 شهادة الـ CE: للمنتج النهائي بكامل مكوناته و ملحقاته وموديلاته صادرة من (Notified body) مع مراعاة ملحق المواصفة (Annex) طبقاً للـ classification الخاص بالمنتج فى حالة احتواء المستلزم على مادة من اصل حيوانى bovine يلزم احتواء شهادة الـ CE على:
EU722/2012 (The Regulation replaces the Commission Regulation existing requirements contained in Directive 2003/32/EC concerning medical devices manufactured utilizing tissues of animal origin (TSE-susceptible animals in Medical devices
** لا يشترط تقديم شهادة الـ CE للمستلزمات الطبية المصنفة Class I Non-Sterile

(4 شهادة ISO 13485:2016 او شهادة EN ISO 13485:2016 صادرة من جهة منح شهادات معتمدة دولياً على أن تغطى الـ Product category

(5 شهادة Declaration of conformity مختومة و موقعة من المصنع القانونى تشمل الاسم التجارى للمستلزم والأكواد او المقاسات و تشمل kit/set contents فى حالة kit/set على ان يذكر الاتي :
ان الجودة على مسنولية المصنع الاجنبى الـ Notified body رقم شهادة CE الخاصة بالمستلزم Indication of use Classification و تحتوى على المصنع الفعلى إن وجد أو ملحق لها.

طبقاً لقواعد كندا

- 1- Declaration of conformity according to Canadian regulation
Acc. to the form <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medical-devices/application-information/forms/declaration-conformity-forms-medical-devices.html>
- 2- Manufacturer certificate to cover export of medical devices issued from: The Health Products and Food Branch Inspectorate (HPFBI), Health Canada
- 3-Medical device active license for medical devices class II, III, and IV
- 4-medical device establishment license for medical device class I
- 5-ISO 13485:2016 certificate
- 6- Declaration letter mentions full medical device list submitted to the Egyptian health authority in case Medical device active license is issued for medical device family, medical

device group, or medical device group family, this declaration letter will be sent to the health Canada to confirm that the license covers the whole medical device list

محتويات الملف الفني على ورق المصنع القانوني مختوم وموقع من المصنع القانوني ويحتوى على الاسم التجارى للمستلزم:

- 1 شهادة بيان التركيب (R.M composition)
 - 2 شهادة تحليل المستلزم (analysis certificate): physical-chemical-biological
 - *Covering letter for the analysis confirming that applied method is according to manufacturing standard and under the manufacturer responsibility (mentioning all the manufacturing standards)
*يتم الاكتفاء بشهادة التحليل الواردة فى الملف وذلك بموجب خطاب من الشركة المصنعة يفيد ان الطريقة المستخدمة وفقا لمواصفات التصنيع وعلى مسئولية المصنع.
 - 3 شهادة عقامة للمستلزم (Sterilization certificate)
لا تطلب فى حالة المستلزمات الطبية غير المعقمة.
 - 4 شهادة بالمواد المستخدمة فى تغليف المستلزم و الأعداد (Packaging material & Number of units)
 - 5 وصف بيانات البطاقة الخارجية والداخلية للعبوة (Inner &Outer Label) وعينة من الملصق المرجعي (Master Label) و النشرة الداخلية مختومة و موقعة من الشركة المنتجة و 2 نسخة من art work الأصلية للعبوة الداخلية والخارجية مختوم و موقع من الشركة المنتجة.
 - 6 كتالوج لوصف المستلزم و توضيح اجزائه و الاستخدام فى حالة الحاجة الى توضيح.
 - 7 IFU الخاصة بالمستلزم اصل معتمد موقع و مختوم من الشركة المنتجة.
- فى حالة Electronic labeling يتم تقديم IFU من المصنع الاجنبى فى ملف تسجيل المستلزم الطبى و ارفاقها مع اخطار التسجيل بعد صدوره بالاضافة الى artwork معتمد من المصنع القانونى تتضمن العبارة التالية :
- (Instruction for use in printed paper form can be provided at the latest within 7 calendar days of receiving a request from the user)
- 8 شهادة مدة صلاحية المنتج (Shelf Life) يذكر بها الإسم التجارى للمنتج و ظروف التخزين (Storage (Condition).
 - 9 اصل اخطار التسجيل السابق فى حالة إعادة التسجيل
 - 10 عينة من المستلزم المراد تسجيله
 - 11 فى حالة المستلزم المصنف Class I Non-Sterile يتعين إحضار: شهادة مطابقة للمواصفات القياسية للمستلزم
- Compliance with essential requirement and harmonized standards check list**

ملحق (2) محتويات ملف تسجيل/إعادة تسجيل مستلزم طبي محلي (معقم او غير معقم)

- 1- اىصال دفع رسوم التسجيل/إعادة تسجيل
 - 2- اصل التفويض معتمد من رئيس مجلس الإدارة مع التصديق البنكي عن التوقيع بالشخص المسنول عن التعامل مع ادارة تسجيل المستلزمات الطبية و استلام اخطارات التسجيل.
 - 3- تعهد الالتزام باجراءات الامونية وفقا للأعلان الصادر من مدير عام مركز اليقظة الصيدلانية المصرى و المعتمد من رئيس الإدارة بتاريخ 2018/04/24 و تاريخ 2019/08/08.
 - 4- المتقدم بالطلب:
 - أ. مصنع محلي
 - ب. مصنع منطقة حرة
- للمصانع المحلية يطلب الاتى:
نظام الترخيص السابق:
*السجل التجارى

- * رخصة المنشأة الصناعية
- * البطاقة ضريبية
- * رخصة المصنع صادرة من هيئة الدواء المصرية
- في حالة مصانع المنطقة الحرة لا تطلب رخصة المنشأة الصناعية و يطلب الترخيص الصادر من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة
- نظام الترخيص الحالي:
- * رخصة التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية
- * السجل التجارى
- * البطاقة الضريبية
- * شهادة بيانات المصنع صادرة من الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية

5- خطاب من المصنع موقع ومختوم يوضح ماهى الخطوات التى يقوم بها المصنع فى تصنيع المستلزمات المقدمة للتسجيل

- 6- الشهادات المطلوبة سارية التاريخ لمدة لا تقل عن 3 شهور على الاقل من تاريخ تسليم الملف:
- i. شهادة ال (CE (Acc.to 93/42/EC) للمنتج النهائي بكامل مكوناته و ملحقاته و موديلاته صادرة من (Notified body) مع مراعاة ملحق المواصفة (Annex) طبقا لل classification الخاص بالمنتج
- * فى حالة احتواء المنتج على مادة من اصل حيوانى يلزم احتواء شهادة ال CE 722/2012 :

concerning active implantable medical devices and medical devices manufactured utilizing tissues of animal origin has been published in the Official Journal of the European Union. The Regulation replaces the existing requirements contained in Directive 2003/32/EC tissues from TSE-susceptible animals in Medical devices.

** لا يشترط تقديم شهادة ال CE للمستلزمات الطبية المصنفة Class I Non-Sterile

ii. شهادة ISO 13485:2016 صادرة من جهة منح شهادات معتمدة دوليا على أن تغطى ال Product category

أو يتم احضار الآتى:

شهادة (FDA Clearance) 510K صادرة من ال US FDA بالإضافة الى شهادة EN ISO 13485:2016 صادرة من

جهة منح شهادات معتمدة دوليا على أن تغطى ال Product category

iii. شهادة Declaration of conformity مختومة و موقعة من المصنع القانونى تشمل الاسم التجارى للمستلزم والأكواد او المقاسات و تشمل kit/set contents فى حالة kit/set وتحتوي على الاتي:

* ان الجودة على مسنولية المصنع

* ال- Notified body

* رقم شهادة CE الخاصة بالمستلزم

* classification & Indication of use و تحتوى على المصنع الفعلى إن وجد أو ملحق لها.

7- محتويات الملف الفني على ورق المصنع القانونى مختوم وموقع من المصنع القانونى ويحتوى على الاسم التجارى للمستلزم:

أ- شهادة بيان التركيب (R.M Composition)

* Approved Supplier List

* List of PVC codes & grade

ب- Sketch Diagram

ج- شهادة تحليل المنتج physical –chemical biological : analysis certificate

****Covering letter for the analysis confirming that applied method is acc. to manufacturing standard and under the manufacturer responsibility (mentioning all the manufacturing standards)**

يتم الاكتفاء بشهادة التحليل الواردة في الملف وذلك بموجب خطاب من الشركة المصنعة يفيد ان الطريقة المستخدمة وفقا لمواصفات التصنيع وعلى مسؤولية المصنع وفقا لمنشور 12 لسنة 2012.

د-نسخة من دراسة الثبات التي سوف يتم عرضها على لجنة الثبات Stability study طبقا للدلائل الارشادية المنظمة لاجمال اللجنة العلمية المتخصصة لتقييم دراسات الثبات (Biocompatibility) الخاصة بالمستلزمات الطبية
*لا يشترط تقديم Biocompatibility Test Report and stability study للمستلزمات الطبية المقدمة للتسجيل أو إعادة التسجيل المحلية التصنيع و المتداولة في الدول المرجعية.

* يتعين على المصنع اثبات ظروف التخزين الواردة بدراسة الثبات في ال Labeling الخاصة بالمستلزم الطبي ومتابعة الالتزام بظروف التخزين من قبل الادارة المركزية للعمليات.

ه- شهادة عقامة للمنتج (Sterilization certificate)

و- شهادة بالمواد المستخدمة في تغليف المنتج والأعداد (Packaging material & Number)

ز- وصف بيانات البطاقة الخارجية والداخلية للعبوة (Inner & Outer Label)

ح- عينة من الملصق المرجعي (Master Label) و النشرة الداخلية مختومة من المصنع الأصلية للعبوة الداخلية و الخارجية مختوم و موقع من المصنع.

ط- كتالوج لوصف المستلزم و توضيح اجزائه و الاستخدام في حالة الحاجة الى توضيح.

ك- شهادة مدة صلاحية المنتج (Shelf Life) يذكريها الإسم التجاري للمنتج و ظروف التخزين (Storage Conditions)

ل- اصل اخطار التسجيل المنتهى الصلاحية في حالة إعادة التسجيل

م- عينة من المنتج المراد تسجيله

**في حالة المستلزم المصنف Class I Non-Sterile يتعين إحضار: شهادة مطابقة للمواصفات القياسية للمستلزم

Compliance with essential requirement and harmonized standards check list

ملحق (3) طلبات استلام ملف المستلزمات الطبية للتسجيل بنظام التصنيع لدى الغير (F-TOLL) (معقم و غير معقم)

- 1- ايصال دفع رسوم التسجيل /إعادة تسجيل
- 2- الالتزام باجراءات الأمانة وفقا للإعلان الصادر من مدير عام مركز اليقظة الصيدلانية المصري و المعتمد من رئيس الإدارة بتاريخ 2018/04/24 و تاريخ 2019/08/08.
- 3- اصل التفويض صادر من "صاحب اخطار التسجيل" معتمد من رئيس مجلس الادارة وموثق من خلال مكتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري عن التوقيع بالشخص المسنول عن التعامل مع ادارة تسجيل المستلزمات الطبية و استلام اخطارات التسجيل.
- 4- عقد تصنيع لدى الغير ساري بين "صاحب اخطار التسجيل" و "المصنع" يوضح مسؤولية الطرفين من حيث legality & technicality موقع ومختوم من الطرفين وموثق من خلال مكتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري - على ان يتم مراجعته و اعتماده من خلال ادارة الشؤون القانونية بهينة الدواء المصرية على أن يتضمن العقد ما يلي:

أن " صاحب اخطار التسجيل " مسنول مسؤولية كاملة عن التالي :

- جودة المنتج و العقامة وكافة خطوات التصنيع على ان يشترك المصنع الفعلى في المسؤولية الفنية عن الجودة
- تسجيل المستلزمات لدى هيئة الدواء و ابلاغها عن اى متغيرات تخص المستلزم

- ان تصدر الموافقة الاستيرادية الخاصة بخامات الإنتاج باسم المصنع الفعلي لصالح صاحب إخطار التسجيل " License Holder " على ان تحتوي الفاتورة الواردة على رقم تشغيل المادة الخام
- توزيع المستلزم الطبي مع مراعاة ان يكون التخزين بدءاً من المواد الخام المستورده لحين الافراج عن المنتج النهائي بمخزن مرخص طبقاً للعقد المبرم بين الطرفين
- الاحتفاظ بسجل دائم اصلي يشمل المستلزمات الطبية التي يتعامل فيها و أرقام وحجم التشغيلات و مكان تصنيعها و أماكن توزيعها طوال مدة تسجيل هذه المستلزمات و يتم التفتيش الدورى على هذه السجلات بمقر "المصنع الفعلى " بمعرفة الادارة المركزية للعمليات طبقاً للقواعد على ان تتواجد صورة السجلات بمقر "صاحب اخطار التسجيل".
- تطبيق نظم الجودة لدى المصنع الفعلى و يحق للادارة المركزية للعمليات الطبية التحقق من تطبيق معايير و اجراءات الجودة لدى المصنع الفعلى و على "صاحب اخطار التسجيل" اتخاذ كافة الاجراءات لتيسير مهمة الادارة المركزية للعمليات
- وجود نظام يقظة المستلزمات الطبية، وبتابعة جميع انشطته ومتطلباته وفقاً للدلائل الإسترشادية لنظام يقظة المستلزمات الطبية مع إدارة مأمونية المستلزمات الطبية
- الإبلاغ عن اي إجراءات سحب (Recall) او (FSN) او (FSCA) تتم عالمياً او اي حوادث (Incidents) يتم رصدها في جمهورية مصر العربية لإدارة مأمونية المستلزمات الطبية ، وفقاً للدلائل الإسترشادية لنظام يقظة المستلزمات الطبية
- تقديم العون اللازم لممثلى الادارة المركزية للعمليات لدى زيارتهم للتفتيش على خط الانتاج و ذلك من خلال تحديد شخص يقوم بهذه المهام و يكون مسنولاً عن اعتماد الملف الفنى للمستلزم
- فى حالة تغيير الشخص المسنول عن خط الانتاج يتم ابلاغ الادارة المركزية للعمليات
- لا يحق لصاحب إخطار التسجيل انتاج نفس المستلزم الطبي بنظام التصنيع لدى الغير (كمصنع فعلى) لصالح صاحب إخطار (License Holder) آخر
- لا يحق للمصنع الفعلى الانتاج الا بعد إصدار إخطار التسجيل على ان يحتفظ المصنع الفعلى فى سجلاته باخطارات التسجيل
- الطرف المسنول عن توريد المواد الخام للـ "مصنع".

5- بالنسبة لـ "صاحب إخطار التسجيل":

- السجل التجارى و البطاقة الضريبية على ان تتضمنا نشاط تصنيع المستلزمات الطبية لدى الغير و التجارة
- رخصة مصنع مستلزمات طبية / ادوية وفقاً للقواعد المتبعة لا يشترط ان تتضمن خط الانتاج الخاص بالمستلزم المراد تسجيله

6- بالنسبة لـ "مصنع":

- رخصة مصنع مستلزمات طبية وفقاً للقواعد المتبعة على ان تتضمن خط الانتاج الخاص بالمستلزم المراد تسجيله
- السجل التجارى و البطاقة الضريبية على ان تتضمنا نشاط تصنيع المستلزمات الطبية.
- 7- الشهادات المطلوبة سارية التاريخ لمدة لا تقل عن 3 شهور على الأقل من تاريخ تسليم الملف:
 - شهادة ال (CE (Acc.to 93/42/EC) للمنتج النهائي بكامل مكوناته و ملحقاته و موديلاته صادرة من (Notified body) مع مراعاة ملحق المواصفة (Annex) طبقاً لل classification الخاص بالمنتج
 - *فى حالة احتواء المنتج على مادة من اصل حيوانى يلزم احتواء شهادة ال CE 722/2012 :

Concerning active implantable medical devices and medical devices manufactured utilizing tissues of animal origin has been published in the Official Journal of the European Union. The Regulation replaces the existing requirements contained in Directive 2003/32/EC tissues from TSE-susceptible animals in Medical devices.

**** لا يشترط تقديم شهادة الـ CE للمستلزمات الطبية المصنفة Class I Non-Sterile**

ii. شهادة ISO 13485:2016 صادرة من جهة منح شهادات معتمدة دوليا على أن تغطي الـ Product category أو يتم احضار الآتى:

شهادة (FDA Clearance) 510K صادرة من الـ US FDA بالإضافة الى شهادة EN ISO 13485:2016 صادرة من جهة منح شهادات معتمدة دوليا على أن تغطي الـ Product category

iii. شهادة Declaration of conformity صادرة من " صاحب اخطار التسجيل " موقعة و مختومة تذكر: اسم "المصنع" و مقره.

* اسم المستلزم الطبى تفصيليا (الاسم التجاري للمستلزم الطبى و موديلاته والأكواد او المقاسات و تشمل kit/set contents فى حالة kit/set) مواصفة التصنيع.

* ان الجودة على مسئولية " صاحب اخطار التسجيل " مع الالتزام بالمسئوليات الموضحة بالعقد اسم " " صاحب اخطار التسجيل " وعنوانه (License Holder)

الـ Notified body

* رقم شهادة CE الخاصة بالمستلزم

Indication of use&

* Classification

8- Approved Supplier List صادرة من الطرف المسئول عن توريد الخامات موقعة و مختومة و تقع مسئولية الـ Supplier Qualification على هذا الطرف.

9- تفويض صادر من " صاحب اخطار التسجيل " معتمد من رئيس مجلس الادارة وموثق من خلال مكتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري عن التوقيع بالشخص المسئول عن اعتماد بيانات الملف الفني المقدم للتسجيل بشرط موافقته للقيام بذلك مع ذكر وظيفته فى المصنع و التى تؤهله لاعتماد الملف الفني و المعتمد فى قيد سجل بالتصنيع لدى الغير.

10- الملف الفني الخاص بالمستلزم الطبى صادر من المصنع موقع و مختوم على ان يتم ارفاقه بخطاب معتمد من "صاحب اخطار التسجيل" يتعهد فيه بمسئوليته الكاملة عن جميع البيانات الواردة بالملف الفني المرفق و يذكر فى كل مستنداته اسم المستلزم الطبى متضمناً الآتى :

أ- شهادة بيان التركيب (R.M Composition)

*List of PVC codes& grade

ب- Sketch Diagram

ت- شهادة تحليل المنتج physical-chemical-biological : analysis certificate

*Covering letter for the analysis confirming that applied method is acc. to manufacturing standard and under the manufacturer responsibility (mentioning all the manufacturing standards)

يتم الاكتفاء بشهادة التحليل الواردة فى الملف وذلك بموجب خطاب من الشركة المصنعة يفيد ان الطريقة المستخدمة وفقا لمواصفات التصنيع وعلى مسئولية المصنع وفقا لمنشور 12 لسنة 2012

ث- نسخة من دراسة الثبات التى سوف يتم عرضها على لجنة الثبات Stability study طبقا للدلائل الارشادية المنظمة لاعمال اللجنة العلمية المتخصصة لتقييم دراسات الثبات (Biocompatibility) الخاصة بالمستلزمات الطبية

*لا يشترط تقديم and Biocompatibility Test Report stability study للمستلزمات الطبية المقدمة للتسجيل أو إعادة التسجيل المحلية التصنيع و المتداولة فى الدول المرجعية.

*يتعين على المصنع اثبات ظروف التخزين الواردة بدراسة الثبات فى الـ Labeling الخاصة بالمستلزم الطبى ومتابعة الالتزام بظروف التخزين من قبل الادارة المركزية للعمليات.

ج- شهادة عقامة للمنتج (Sterilization certificate)

ح- شهادة بالمواد المستخدمة في تغليف المنتج والأعداد (Packaging material & Number)

خ- وصف بيانات البطاقتين الخارجية والداخلية للعبوة (Inner & Outer Label) :
عينة من الملصق المرجعي (Master Label) و النشرة الداخلية مختومة من "المصنع" على ان يذكر على البطاقتين
عبارة :

- انتاج (اسم "المصنع") لصالح (اسم " صاحب اخطار التسجيل ")
- وكذلك ذكر عنوان كلا من "المصنع" و " صاحب اخطار التسجيل " وبلد المنشأ.
- كتالوج لوصف المستلزم و توضيح اجزائه و الاستخدام في حالة الحاجة الى توضيح.

د- شهادة مدة صلاحية المنتج (Shelf Life) يذكر بها الاسم التجارى للمنتج و ظروف التخزين. (Storage Conditions)

اصل اخطار التسجيل المنتهى الصلاحية في حالة اعادة التسجيل

ذ- عينة من المنتج المراد تسجيله

ر- خطاب من "المصنع" موقع ومختوم يوضح ماهى الخطوات التى يقوم بها المصنع فى تصنيع المستلزمات المقدمة

للتسجيل

ز- تقرير الادارة المركزية للعمليات الذى يوضح توافر خط الانتاج وانه لا توجد عليه مخالفات تتعارض مع اشتراطات

التصنيع الجيد (وذلك عن طريق المراسلة للإدارة المركزية للعمليات)

في حالة المستلزم المصنف Class I Non-Sterile يتعين إحضار: شهادة مطابقة للمواصفات القياسية للمستلزم

Compliance with essential requirement and harmonized standards check list

ملحق (4) المستندات المطلوبة للعرض على اللجان العلمية المتخصصة

❖ أولاً: فيما يخص المستلزمات الطبية المقدمة للتسجيل /إعادة التسجيل

يجب التقدم بنسخه واحده من المستندات الاتييه :

- شهادة بيان التركيب (Material composition)
- Catalogue & insert leaflet تحتوي على intended use
- شهادات الجودة و التي تتضمن الاتي:
 - ↪ Declaration of conformity
 - ↪ Free sale(from a reference country) + CE Certificate + ISO 13485
 - ↪ Certificate for foreign government From (US FDA)+ ISO 13485(If no GMP statement in FDA)
- قد يتم طلب تقديم سابقة أعمال مختومة ومعتمدة من الأماكن التي سبق استخدام المستلزم فيها في دول مرجعية وكذلك احضار efficacy & clinical trials for the product published in reputable scientific journals on safety & efficacy في حالة طلب اعضاء اللجنة العلمية .

❖ ثانيا: مستندات اضافية تقدم وفقاً لتخصص اللجنة او نوع المستلزم الطبي

<p>- مطابقة صادرة من الإدارة المركزية للرقابة الدوائية لمقاس واحد فقط من كل نوع من الخيوط الجراحية المقدمة للتسجيل الجديد / إعادة التسجيل الوارده من دول غير مرجعيه متضمنه اختبار tensile strength بالإضافة الى الاختبارات الأخرى التي تقوم بها الإدارة المركزية للرقابة الدوائية .</p>	<p>Surgical sutures اللجنة العلمية المتخصصة للجراحة العامة وجراحة التجميل</p>
<p>للمستلزمات الطبية المقدمة لإعادة التسجيل يتم تقديم الآتي: - بيان بأوامر توريد خلال السنوات الثلاثة الماضية لاي مستلزم مقدم لإعادة التسجيل بالإضافة الى تقديم استبيان عن حجم التعامل و كفاءة المستلزم و الآثار الجانبية التي لوحظت من الأماكن التي تستخدم المستلزم الواردة في البيان. بشأن المستلزمات المقدمة للتسجيل الجديد والمصنفة Class Iib, III & Implantable يتم احضار أي من الآتي: - Long- term Scientific Papers on Safety & Efficacy & Clinical Trials published in reputable journals - وأفضلية إحضار سابقة أعمال تعدد بها اللجنة (الأماكن التي سبق استخدام المستلزم فيها) في دول مرجعية مع عدم وجودها. - أو أن يكون المستلزم تم انتاجه في شركة دولية لها سمعتها الجيدة في السوق الدولي.</p>	<p>اللجنة العلمية المتخصصة لأمراض وجراحة الكلى:</p>
<p>- وجوب احضار عينات من جميع المقاسات</p>	<p>I.V. Cannula اللجنة العلمية المتخصصة لأمراض التخدير</p>
<p>- وجوب احضار عينة من كل فئة عمرية</p>	<p>السرنجات اللجنة العلمية لأمراض الدم</p>
<p>للمستلزمات الطبية الواردة من دول غير مرجعية بجميع التصنيفات (I, Ila, Iib& III) يتم تقديم الآتي : - clinical trials published in reputable scientific journals - سابقة أعمال معتمدة ومختومة من المراكز والمستشفيات التي سبق استخدام المستلزم بها في الدول المرجعية)</p>	<p>اللجنة العلمية المتخصصة لأمراض وجراحة الجهاز الهضمي والكبد</p>
<p>- شهادة بيان التركيب (Material composition) - intended use Catalogue & insert leaflet تحتوي على - Inner & outer labels</p>	<p>المستلزمات الطبية التي هي في صورة Dosage Form</p>
<p>- الغلاف الخارجي لل pen needles الذي يذكر جميع أنواع الأقلام المتوافقة التي تستخدم معه - لا يشترط تقديم عينة من كل نوع من الأقلام المذكورة على الغلاف الخارجي للمستلزم و يكفي بتقديم عينات عشوائية للتقييم من قبل اللجنة العلمية.</p>	<p>Pen Needles اللجنة العلمية المتخصصة للغدد الصماء والسكر</p>
<p>للمستلزمات الطبية الواردة من دول غير مرجعية و التي تزرع داخل الجسم implantable يتم تقديم : سابقة أعمال (الأماكن التي سبق استخدام المستلزم فيها) في دول الإتحاد الأوروبي. -Long- term Scientific Papers on Safety & Efficacy & Clinical Trials published in reputable journals</p>	<p>اللجنة العلمية المتخصصة لأمراض المخ والأعصاب</p>

<p>خطاب يفيد بالاتي :</p> <ul style="list-style-type: none">- تحديد نوع الـ staplers سواء كانت 2 or 3 rows- تحديد نوع الـ staplers سواء كانت laparoscopic or Open surgery- تحديد موقف الـ reloading units من التسجيل الخاصه بال stapler المقدمه للعرض .	<p>Staplers اللجنة العلمية المتخصصة للجراحة العامة وجراحة التجميل</p>
---	--

❖ ثالثا : بخصوص مستلزمات العظام التي تزرع داخل الجسم:

أ- فيما يخص مستلزمات العظام محلية الصنع:

نوع المستلزم	مستلزم طبي معقم	مستلزم طبي غير معقم
الاجراءات		بعد حصول الشركة على موعد لتقديم ملف التسجيل: يتم اتباع الاجراءات المعمول بها للحصول على الموافقة الاستيرادية لحين الحصول على اخطار التسجيل.
اثناء التسجيل		<p>1- اعتماد approved raw material supplier list من قبل اللجنة العلمية لامراض و جراحة العظام على أن يتم اخطار الادارات المختصة بها.</p> <p>2- تطبيق قرار اللجنة المختصة بتسجيل المستلزمات الطبية بتاريخ 2018/03/15 بالاتي: أ. قيام الادارة المركزية للعمليات بسحب العينات اللازمة لاجراء الاختبارات عليها في أحد المعامل المعتمدة من International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) بالاضافة الى اجراء التحاليل بأى من كليات الهندسة</p> <p>ب. في حالة عدم وجود معامل معتمدة في جمهورية مصر العربية : يتم تصدير العينات بعد حصول الشركة على موافقة ادارة التصدير لاجراء الاختبارات عليها وذلك على مسنولية المصنع.</p> <p>ت. قيام المعمل المعتمد بارسال نتائج الإختبارات الى ادارة تسجيل المستلزمات الطبية لعرضها على اللجنة العلمية للعظام للتقييم.</p> <p>ث. مراعاة أن جميع الاجراءات والمستندات والاختبارات تتضمن نفس ارقام التشغيلات التي تم سحبها. وفي حالة ثبوت ثمة تلاعب في العينات أو نتائج الاختبارات يتم اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.</p> <p>3- تطبيق اجراءات المأمونية اثناء التسجيل طبقا لما هو متبع في هذا الشأن.</p>
بعد الحصول على إخطار تسجيل		<p>يتم تطبيق القواعد المتبعة على أن تقوم الادارة المركزية للعمليات بسحب عينات عشوائية لاجراء جميع الاختبارات الكيميائية و الفيزيائية و الهندسية (وفقا لمواصفة التصنيع) بأى من كليات الهندسة بالتبادل مع معهد بحوث الفلزات في حال اعتماده لاجراء الاختبارات على المنتج النهائي و ليس المواد الخام) بالتبادل مع الادارة المركزية للرقابة الدوائية.</p> <p><u>ملحوظة:</u> لن يتم الزام الشركة بالتحليل في معمل معتمد مرة اخرى في اختبارات ال performance and physical الا في حالة اضافة مورد جديد مختلف عن المعتمد من قبل اللجنة العلمية.</p>

ب. فيما يخص مستلزمات العظام الواردة من دول غير مرجعية:

نوع المستلزم	مستلزم طبي معقم	مستلزم طبي غير معقم
الاجراءات	<p>بعد حصول الشركة على موعد لتقديم ملف التسجيل : يتم اتباع الاجراءات المعمول بها للحصول على الموافقة الاستيرادية لحين الحصول على اخطار التسجيل . ملحوظة: يتم استبيان امانه و فعالية المستلزمات من خلال ادارة الامونية بعد عام من موافقة اللجنه العلمية للحصول على الموافقة الاستيرادية في المستشفيات التي يتم التوريد اليها وتقييم تقارير الامونية من خلال اللجنه العلمية.</p>	
اثناء التسجيل	<p>1- يتم اتباع الاجراءات المعمول بها للحصول على اخطار التسجيل مع تقديم شهادة Free Sale, CE& ISO مع تقديم سابقه اعمال للمستلزم من دولة مرجعية وكذلك تقديم Long-Term Scientific Papers On Safety & Efficacy & Clinical Trials Published In Reputable Journals</p> <p>2- احضار اختبارات على المستلزمات المراد تسجيلها في أحد المعامل المعتمدة من International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) بالإضافة الى اجراء الاختبارات بأى من كليات الهندسة وتقييمها من قبل اللجنه العلمية</p>	<p>احضار اختبارات (وفقا لمواصفة التصنيع) على المستلزمات المراد تسجيلها في أحد المعامل المعتمدة من International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) بالإضافة الى اجراء الاختبارات بأى من كليات الهندسة وتقييمها من قبل اللجنه العلمية</p>
بعد الحصول على إخطار تسجيل	<p>يتم استثناء المستلزمات الطبية التي لها مصنع قانونى فى دولة مرجعية ومصنع فعلى فى دولة غير مرجعية من تقديم الاتى:</p> <p>- سابقه اعمال للمستلزم من دولة مرجعية وكذلك تقديم Long-Term Scientific Papers on Safety & Efficacy & Clinical Trials Published In Reputable Journals</p> <p>- اختبارات على المستلزمات المراد تسجيلها فى أحد المعامل المعتمدة من International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) وتقييمها من قبل اللجنه العلمية.</p> <p>- إختبارات كلية الهندسة .</p>	<p>يتم تطبيق القواعد المتبعة على أن تقوم الادارة المركزية للعمليات بسحب عينات عشوائية لاجراء جميع الاختبارات الكيميائية والفيزيائية والهندسية (وفقا لمواصفة التصنيع) بأى من كليات الهندسة بالتبادل مع معهد بحوث الفلزات في حال اعتماده لاجراء الاختبارات على المنتج النهائي وليس المواد الخام) بالتبادل مع الادارة المركزية للرقابة الدوائية.</p>

*** ملحق (5)**

محتويات الملف المقدم للعرض على اللجنة العلمية المتخصصة لتقييم دراسات الثبات (biocompatibility) الخاصة بالمستلزمات الطبية محلية التصنيع

- 1- دراسة الثبات
- 2- دراسة التوافق الحيوي (biocompatibility)
- *ملحوظة:
- يتم تحديد طريقة التعقيم للمستلزم الطبي الذي يتم اختباره في جميع الدراسات الخاصة باختبارات ال Sensitization & Irritation وذلك طبقا لما ورد بالمواصفة العالمية ISO 10993-10:2010 (A.5 / Page 28)
- 3- بيان تركيب المستلزم الطبي
- 4- شهادة تحليل المستلزم الطبي
- 5- شهادة بالمواد المستخدمة في تغليف المستلزم الطبي والأعداد
- 6- شهادة عقامة للمستلزم الطبي
- 7- شهادة مدة صلاحية المستلزم الطبي
- 8- شهادات الجودة الخاصة بالمستلزم الطبي (Declaration of Conformity, CE, ISO-13485:2016, Free sale or FDA)
- 9- في حالة إعادة التسجيل مطلوب تقديم نسخة من الإخطار السابق
- 10- ضرورة عرض دراسات ثبات المستلزمات الطبية المحلية التصنيع على اللجنة العلمية المتخصصة لدراسة الثبات مرفقا بها عينات محرزة من قبل الادارة المركزية للعمليات ومختومة من الجهة التي قامت باجراء الدراسة (المصنع/معمل معتمد) على أن يتم الاحتفاظ بتلك العينة في المصنع طوال فترة سريان اخطار تسجيل المستلزم الطبي ومتابعة ذلك من خلال الادارة المركزية للعمليات مع إلزام المصنع بتقديم تلك العينة مثبت عليها lot number مطابق للمذكور بدراسة الثبات المقدمة للعرض على اللجنة العلمية المتخصصة لتقييم دراسات الثبات (Biocompatibility) الخاصة بالمستلزمات الطبية
- *فيما يخص تقديم تلك العينة المثبت عليها lot number مطابق للمذكور بدراسة الثبات المقدمة للعرض على اللجنة العلمية المتخصصة لتقييم دراسات الثبات (Biocompatibility) الخاصة بالمستلزمات الطبية يتم تطبيق ذلك القرار على دراسات الثبات التي سيتم اجراؤها بعد نشر القرار على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للمستلزمات الطبية (2018/01/02)
- 12- محضر التحريز المرفق بالعينة المُحرزة من قبل الادارة المركزية للعمليات & نموذج ال checklist الصادر من الادارة المركزية للعمليات والذي تم تطبيقه على معمل المصنع الذي تم اجراء دراسة الثبات به
- 13- وفي حالة عدم توافر امكانية اجراء دراسة الثبات او بعض الاختبارات يمكن للشركة اجراء تلك الاختبارات لدى جهة معتمدة لذلك على ان يتم تقديم شهادة تاهيل/ اعتماد جهة اصدار دراسة الثبات طبقا للمواصفة القياسية العالمية ISO-17025 الصادرة من جهة الاعتماد مع التقدم بما يثبت ان The scope of accreditation لهذه الجهة يتضمن اعتمادها لاجراء الاختبارات المقدمة وتكون نتائج هذه الاختبارات تحت مسؤولية الشركة المنتجة ويمكن ادراج نتائج هذه الاختبارات كجزء من دراسة الثبات للمنتج.

ملحق (6): التعهدات الخاصة بأمونية المستلزمات الطبية .

(COMPANY NAME)

(Date)

MANUFACTURER'S COMMITMENT ABOUT SAFETY OF MEDICAL DEVICES

Declaration (1)

For MDs Class I and IIa

Dear Head of Central administration for medical devices,

Dear Head of Medical Devices Registration Department,

For the following medical device applied for registration/re-registration/variation of marketing authorization in the Arab Republic of Egypt:

- **Medical Device Acceptance Number:**
- **Medical Device Name:**
- **Medical Device Models/Codes/Sizes:**
 - (Company) undertakes that the medical device applied for registration/re-registration/variation, which will be marketed in the Arab Republic of Egypt, has not received any regulatory actions (Including but not limited to recalls, FSNs, or FSCAs) in respect of (Models/Codes/Sizes, Lots/Batches, or Serials), in an interval of (3) three years before the date of application for registration/re-registration/variation.
 - (Company) undertakes that in case of any regulatory actions (Including but not limited to recalls, FSNs, or FSCAs) raised after the application for registration/reregistration/variation and before granting the marketing authorization of the medical device, those regulatory actions concerning the safety of the medical device in respect of (Models/Codes No., Lot/Batch No., or Serial No.) will be informed to the "Medical Devices Registration Department" and communicated to the "Medical Device Safety Department (MDS - EPVC)" by (Agent) - the company's agent in the Arab Republic of Egypt.
 - (Company) undertakes that since granting the marketing authorization of the medical device and during the marketing stage, (Company) will be obliged to communicate any incidents (MIRs), Periodic Summary Reports (PSRs), or regulatory actions (Including but not limited to recalls, FSNs, or FSCAs) to the "Medical Device Safety Department (MDS - EPVC)" by (Agent) - the company's agent in the Arab Republic of Egypt, this is according to the Egyptian Guidelines for Medical Device Vigilance System.
 - (Company) undertakes that there is a vigilance system in place, oversees the vigilance system of the (Agent) - the company's agent in the Arab Republic of Egypt, and makes sure that (Agent) meets all vigilance requirements (in reference to the Egyptian Guideline for Medical Device Vigilance System), and communicates them with the "Medical Device Safety Department (MDS - EPVC)".

Signature

Title

(Date)

في حالة وجود ممثل قانوني للمصنع القانوني يتم تقديم التعهد الآتي:

(COMPANY NAME)

(Date)

Manufacturer's Commitment About Safety Of Medical Devices
For MDs Class I and IIa

Declaration (1)

Dear Head of Central administration for medical devices,

Dear Head of Medical Devices Registration Department,

For the following medical device applied for registration/re-registration/variation of marketing authorization in the Arab Republic of Egypt:

- Medical Device Acceptance Number:
- Medical Device Name:
- Medical Device Models/Codes/Sizes:

- (Company) undertakes that the medical device applied for registration/re-registration/variation, which will be marketed in the Arab Republic of Egypt, has not received any regulatory actions (Including but not limited to recalls, FSNs, or FSCAs) in respect of (Models/Codes/Sizes, Lots/Batches, or Serials), in an interval of (3) three years before the date of application for registration/re-registration/variation.
- (Company) undertakes that in case of any regulatory actions (Including but not limited to recalls, FSNs, or FSCAs) raised after the application for registration/reregistration/variation and before granting the marketing authorization of the medical device, those regulatory actions concerning the safety of the medical device in respect of (Models/Codes No., Lot/Batch No., or Serial No.) will be informed to the "Medical Devices Registration Department" and communicated to the "Medical Device Safety Department (MDS - EPVC)" by (Agent) - the company's agent in the Arab Republic of Egypt.
- (Company) undertakes that since granting the marketing authorization of the medical device and during the marketing stage, (Company) will be obliged to communicate any incidents (MIRs), Periodic Summary Reports (PSRs), or regulatory actions (Including but not limited to recalls, FSNs, or FSCAs) to the "Medical Device Safety Department (MDS - EPVC)" by (Agent) - the company's agent in the Arab Republic of Egypt, this is according to the Egyptian Guidelines for Medical Device Vigilance System.
- (Company) is responsible that there is a vigilance system in place, and for the oversights of the vigilance system of the (Agent) - the company's agent in the Arab Republic of Egypt, and makes sure that (Agent) meets all vigilance requirements (in reference to the Egyptian Guideline for Medical Device Vigilance System), and communicates them with the "Medical Device Safety Department (MDS - EPVC)".

Signature

Title

(Date)

في حالة وجود ممثل قانوني للمصنع القانوني يتم تقديم التعهد الآتي:

COMPANY NAME

Date

Manufacturer's Commitment about Safety of Medical Devices

Declaration (2)

Class IIb, III, AND (I, IIa with Regulatory Actions)

Dear Head of Central administration for medical devices,

Dear Head of Medical Devices Registration Department,

For the following medical device applied for registration/re-registration/variation of marketing authorization in the Arab Republic of Egypt:

- **Medical Device Acceptance Number:**
- **Medical Device Name:**
- **Medical Device Models/Codes/Sizes:**
- (Company) undertakes that in case of any regulatory actions (Including but not limited to recalls, FSNs, or FSCAs) raised after the application for registration/re-registration/variation and before granting the marketing authorization of the medical device, those regulatory actions concerning the safety of the medical device in respect of (Models/Codes No., Lot/Batch No., or Serial No.) will be informed to the "Medical Devices Registration Department" and communicated to the "Medical Device Safety Department (MDS - EPVC)" by (Agent) - the company's agent in the Arab Republic of Egypt.
- (Company) undertakes that since granting the marketing authorization of the medical device and during the marketing stage, (Company) will be obliged to communicate any incidents (MIRs), Periodic Summary Reports (PSRs), or regulatory actions (Including but not limited to recalls, FSNs, or FSCAs) to the "Medical Device Safety Department (MDS - EPVC)" by (Agent) - the company's agent in the Arab Republic of Egypt, this is according to the Egyptian Guidelines for Medical Device Vigilance System.
- (Company) is responsible that there is a vigilance system in place, and for the oversights of the vigilance system of the (Agent) - the company's agent in the Arab Republic of Egypt, and makes sure that (Agent) meets all vigilance requirements (in reference to the Egyptian Guideline for Medical Device Vigilance System), and communicates them with the "Medical Device Safety Department (MDS - EPVC)".

Signature

Title

(Date)

COMPANY NAME

Date

Manufacturer's Commitment about Safety of Medical Devices

Declaration (2)

Class IIb, III, AND (I, IIa with Regulatory Actions)

Dear Head of Central administration for medical devices,

Dear Head of Medical Devices Registration Department,

For the following medical device applied for registration/re-registration/variation of marketing authorization in the Arab Republic of Egypt:

- **Medical Device Acceptance Number:**
- **Medical Device Name:**
- **Medical Device Models/Codes/Sizes:**
- (Company) undertakes that in case of any regulatory actions (Including but not limited to recalls, FSNs, or FSCAs) raised after the application for registration/re-registration/variation and before granting the marketing authorization of the medical device, those regulatory actions concerning the safety of the medical device in respect of (Models/Codes No., Lot/Batch No., or Serial No.) will be informed to the "Medical Devices Registration Department" and communicated to the "Medical Device Safety Department (MDS - EPVC)" by (Agent) - the company's agent in the Arab Republic of Egypt.
- (Company) undertakes that since granting the marketing authorization of the medical device and during the marketing stage, (Company) will be obliged to communicate any incidents (MIRs), Periodic Summary Reports (PSRs), or regulatory actions (Including but not limited to recalls, FSNs, or FSCAs) to the "Medical Device Safety Department (MDS - EPVC)" by (Agent) - the company's agent in the Arab Republic of Egypt, this is according to the Egyptian Guidelines for Medical Device Vigilance System.
- (Company) undertakes that there is a vigilance system in place, oversees the vigilance system of the (Agent) - the company's agent in the Arab Republic of Egypt, and makes sure that (Agent) meets all vigilance requirements (in reference to the Egyptian Guideline for Medical Device Vigilance System), and communicates them with the "Medical Device Safety Department (MDS - EPVC)".

Signature

Title

(Date)

[COMPANY NAME]
(Date)

Dear Head of the Egyptian Pharmaceutical Vigilance Center,

Dear Head of Medical Devices Safety Department,

The following is the list of contacts of safety responsible(s):

No.	Name of The Local Safety Responsible(s)	Title	Name of the Department	Email	Phone Number	Mobile Number

Signature

Title

(Date)

11. قائمة المصطلحات والاختصارات (Glossary)

الاختصار	المصطلح
EDA	Egyptian Drug Authority (هيئة الدواء المصرية)
MOH	Ministry Of Health (وزارة الصحة)
MD	Medical Device (مستلزم طبي)
IVD	In Vitro Diagnostic (مستلزم طبي للتشخيص في المختبر)
IVF	In Vito Fertilization (التلقيح الصناعي)
AIMD	Active Implantable Medical Device (مستلزم طبي يزرع داخل الجسم)
MDR(2017/745)	Medical Device Regulations (القواعد المنظمة للمستلزمات الطبية)
MDD(93/42/EEC)	Medical Device Directive (توجيهات المستلزمات الطبية)
ISO	International Organization for Standardization (المنظمة الدولية للمقاييس)
CE or EC	European Conformity (المطابقة الأوروبية)
FDA	Food & Drug Administration (منظمة الغذاء والدواء)
CFG	Certificate for Foreign Governments (شهادة للحكومات الأجنبية)
CFR	Code Of Federal Regulations (قوانين اللوائح الفدرالية)
FSC or CFS	Free Sale Certificate or Certificate Of Free Sale (شهادة التداول الحر)
NB	Notified Body (جهة اصدار شهادات الجودة)
DOC	Declaration Of Conformity (اعلان المطابقة)
IFU	Instruction For Use (تعليمات الاستخدام)
GMDN Code	Global Medical Device Nomenclature code (المعيار العالمي لتسمية المستلزمات الطبية)
UMDN Code	Universal Medical Device Nomenclature System (النظام العالمي لتسمية المستلزمات الطبية)
OBL	Own Brand Labeling (علامة تجارية خاصة)
OEM	Original Equipment Manufacturer (الشركة المصنعة الاصلية للاجهزة)
FSNs	Field Safety Notices (اشعار السلامة الميدانية)
FSCAs	Field Safety Corrective Actions (الإجراء التصحيحي للسلامة الميدانية)
SMH	Summary Of Marketing History (ملخص تاريخ التسويق)
GMP	Good Manufacturing Practice (ممارسات تصنيعية جيدة)
UDI	Unique Device Identification System (النظام الفريد لتعريف الاجهزة)
510 K	Premarket Notification
PMA	Pre-Market Approval (اعتماد ما قبل التسويق)
MEDDEV	Medical Device Documents (المستندات اللازمة لتسجيل المستلزمات الطبية)
USP	United States Pharmacopeia

ASTM	Accelerated aging of sterile barrier system for medical devices
AIMD	المستلزم الطبي النشط القابل للزرع داخل الجسم
Accessory	ملحقات الأجهزة الطبية التي يتم تصنيعها خصيصاً لإستخدامها مع جهاز طبي



医课汇
公众号
专业医疗器械资讯平台
WECHAT OF
HLONGMED



hlongmed.com
医疗器械咨询服务
MEDICAL DEVICE
CONSULTING
SERVICES



医课培训平台
医疗器械任职培训
WEB TRAINING
CENTER



医械宝
医疗器械知识平台
KNOWLEDG
ECENTEROF
MEDICAL DEVICE



MDCPP.COM
医械云专业平台
KNOWLEDG
ECENTEROF MEDICAL
DEVICE