



中华人民共和国医药行业标准

YY/T 1058—2004
代替 YY 91058~91059—1999

手术器械 鳃部的长度、宽度、厚度和轴直径

Instruments for surgery—
Length, width, thickness and rivet diameter of box joint

2004-11-08 发布

2005-11-01 实施



国家食品药品监督管理局 发布

前 言

本标准是 YY 91058—1999《手术器械 鳃部的宽度、厚度和轴直径》的修订版。

本标准与 YY 91058—1999 的主要区别：

——合并 YY 91058—1999《手术器械 鳃部的宽度、厚度和轴直径》和 YY 91059—1999《手术器械 长方形腮部的长度和间隙》；

——删去鳃部的间隙要求。

本标准自实施之日起，代替 YY 91058—1999《手术器械 鳃部的宽度、厚度和轴直径》、YY 91059—1999《手术器械 长方形鳃部的长度和间隙》。

本标准由国家食品药品监督管理局提出。

本标准由全国外科器械标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂。

本标准主要起草人：章红霞。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

——ZB C30 017—1988；

——YY 91058—1999；

——ZB C30 018—1988；

——YY 91059—1999。

手术器械
鳃部的长度、宽度、厚度和轴直径

1 范围

本标准规定了手术器械鳃部的长度、宽度、厚度和轴直径。
本标准适用于迭鳃式、穿鳃式、镶鳃式的钳类产品选用。

2 分类与命名

2.1 钳类产品鳃部的长度应符合图 1 和表 1 的规定。

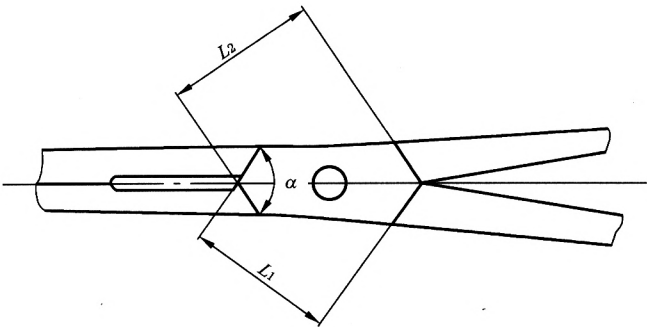


图 1 鳃部正面
表 1 鳃部的长度

$L_1、L_2/mm$	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32
α	$90^{\circ}\sim120^{\circ}$											

2.2 钳类产品鳃部的宽度、厚度、轴直径及厚度的比例应符合图 2 和表 2、表 3 的规定。

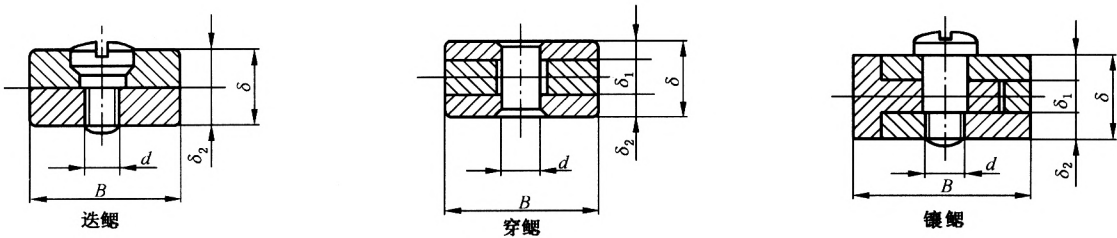


图 2 鳃部剖面

表 2 鳃部宽度、厚度和轴直径

单位为毫米

d	B	δ																
		2.0	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	3.0	▲	▲															
	3.2		▲	▲														
1.4	3.6			▲	▲													
	4.0				▲	▲												
1.6	5.0					▲	▲											
	5.5					▲	▲											
	5.8						▲	▲										
	6.0						▲	▲										
2.0	6.5						▲	▲										
	7.0						▲	▲	▲									
	7.5							▲	▲	▲								
	8.0							▲	▲	▲								
2.5	9.0							▲	▲	▲	▲							
	10.0								▲	▲	▲							
	11									▲	▲	▲						
3	12										▲	▲	▲	▲				
	14												▲	▲	▲			
4	16													▲	▲	▲		
	18														▲	▲	▲	
5	18															▲	▲	▲
	18																▲	▲

注：表中有▲符号者为优先采用。

表 3 鳃部厚度比例

单位为毫米

δ			2.0	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10	11	12
穿鳃、 镶鳃厚 度比例 $\delta_2 : \delta_1 : \delta_2$	2.75 : 4.5 : 2.75	δ_2	0.55	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.25	1.4	1.5	1.65	1.9	2.1	2.45	2.75	3.0	3.3
		δ_1	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.5	2.7	3.2	3.8	4.1	4.5	5.0	5.4
		δ_2	0.55	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.25	1.4	1.5	1.65	1.9	2.1	2.45	2.75	3.0	3.3
	3 : 4 : 3	δ_2	0.6	0.65	0.75	0.85	0.95	1.1	1.2	1.35	1.5	1.65	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6
		δ_1	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8
		δ_2	0.6	0.65	0.75	0.85	0.95	1.1	1.2	1.35	1.5	1.65	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6

中华人民共和国医药
行 业 标 准
手术器械
鳃部的长度、宽度、厚度和轴直径
YY/T 1058—2004

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.bzcbbs.com

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 6 千字
2005 年 4 月第一版 2005 年 4 月第一次印刷

*

书号: 155066 · 2-16128 定价 8.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



YY/T 1058-2004